



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA N° 58, CENTRO - ARAPORÃ-MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORA.MG.GOV.BR

EXTRATO DO CONTRATO N° 074/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ/MG.
CONTRATADA: ITAMAR DE OLIVEIRA CAMPOS EIRELI
PROCESSO: 032/2023.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para EVENTUAL e FUTURA contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de EQUIPE DE APOIO ORGANIZACIONAL a serem utilizados durante os eventos públicos realizados pelo Município de Araporã/MG.
Prazo: O presente contrato tem vigência até 18/06/2023, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, nos termos da Lei nº 8.666/93.
Data contrato: 16/06/2023.
O Valor Global deste Contrato é de R\$ 4.656,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e seis reais).
Dotação Orçamentária: 02.04.01.20029.13392.0039.3.3.90.39 FICHA 231
Fundamentação Legal: O presente contrato tem fundamento à licitação realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2023 objeto do Processo Licitatório n° 032/2023, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal n°. 8.666, de 23 de junho de 1993, Decreto Municipal n. 1.001/06 de 28 de julho de 2006e Decreto Municipal n° 3.219/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA N° 58, CENTRO - ARAPORÃ-MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORA.MG.GOV.BR

EXTRATO DO CONTRATO N° 075/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ/MG.
CONTRATADA: JOSE WALTER ALVES DE OLIVIERA JUNIOR
PROCESSO: 056/2023.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para EVENTUAL e FUTURA contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de BRIGADISTAS PROFISSIONAIS a serem utilizados durante os eventos públicos realizados pelo Município de Araporã/MG.
Prazo: O presente contrato tem vigência até 18/06/2023, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, nos termos da Lei nº 8.666/93.
Data contrato: 16/06/2023.
O Valor Global deste Contrato é de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária: 02.04.01.20029.13392.0039.3.3.90.39 FICHA 231
Fundamentação Legal: O presente contrato tem fundamento a licitação realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2023 objeto do Processo Licitatório n° 056/2023, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal n°. 8.666, de 23 de junho de 1993, Decreto Municipal n. 1.001/06 de 28 de julho de 2006 e Decreto Municipal n° 3.219/2017.

19/06/2023, 10:06

LICITANET - Termo de Homologação



MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG



PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 065/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada e regularidade dos atos procedimentais, così HOMOLOGA nos termos do Item 18 do Art. 13 do Decreto nº 10.240/2016 o resultado do procedimento licitatório em aplicação, nos termos do REGISTRO DE PREÇOS para EVENTUAL e FUTURA aquisição de PRODUTOS AVANÇADOS, PRODUTOS COSMÉTICOS/CONFORTO PESSOAL E DE PERFUMARIA, em atendimento as solicitações de diversas Secretarias do Município de Araporã/MG, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I e demais documentos em Edital.

Fornecedor : UNHA & COR COSMETICOS LTDA - 17.513.233/0002-71

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ., %	Economia R\$
1	20,00	UN	marriage	marriage	R\$ 18,00	R\$ 360,00	R\$ 32,58	R\$ 651,60	44,73	R\$ 14,38
Descrição: ALICATE PARA CUTCULAS USO PROFISSIONAL EM INOX MARCA DE REFERENCIA MANDALI.										
2	20,00	UN	fermax	fermax	R\$ 6,50	R\$ 130,00	R\$ 12,63	R\$ 252,60	48,54	R\$ 8,12
Descrição: AMOLECEDOR DE CUTÍCULA 100G, COM BRICO APLICADOR.										
5	20,00	OL	veneca	veneca	R\$ 49,91	R\$ 998,20	R\$ 49,91	R\$ 998,20	0,00	R\$ 0,00
Descrição: CONDICIONADOR NEUTRO CONTEUDO 5 LITROS										
6	60,00	UN	saibon line	saibon line	R\$ 21,02	R\$ 1.261,20	R\$ 21,02	R\$ 1.261,20	0,00	R\$ 0,00
Descrição: CREME DEFREZANTE TERMINADO 200 G E ML.										
7	40,00	UN	shibansha	shibansha	R\$ 15,23	R\$ 609,20	R\$ 15,23	R\$ 609,20	0,00	R\$ 0,00
Descrição: CREME ESPUMANTE PARA OS PÉS CONTEUDO 240 G.										
12	8,00	UN	verita	verita	R\$ 59,80	R\$ 478,40	R\$ 58,68	R\$ 548,44	12,93	R\$ 8,88
Descrição: ESCOVA DE CABELO TERNICA No 14 CERDAS DE JAVALI/MBETA										
13	8,00	UN	verita	verita	R\$ 59,00	R\$ 472,00	R\$ 58,92	R\$ 727,36	35,11	R\$ 31,82
Descrição: ESCOVA DE CABELO TERNICA No 18 CERDAS DE JAVALI/MBETA										
14	8,00	UN	verita	verita	R\$ 63,20	R\$ 505,60	R\$ 79,58	R\$ 636,64	20,58	R\$ 18,38
Descrição: ESCOVA DE CABELO TERNICA No 20 CERDAS DE JAVALI/MBETA										
15	10,00	UN	verita-oliva	verita-oliva	R\$ 31,51	R\$ 315,10	R\$ 31,51	R\$ 315,10	0,00	R\$ 0,00
Descrição: ESCOVA ROLANTE E BIVAL PARA DESEMBARACAR TODOS OS TIPOS DE CABELO.POSSUI CABO EMBORRACHADO, CERDAS EM NYLON COM BOLINHAS NAS PONTAS QUE PERMITE DESEMBARACAR TOTAL DOS FIOS.										
16	5,00	UN	belitz	belitz	R\$ 45,70	R\$ 228,50	R\$ 57,31	R\$ 286,55	20,28	R\$ 11,81
Descrição: ESCOVA VAZADA TERNICA 40 MM REDONDA CERDAS EM NYLON										
					Subtotal Adjudicado R\$ 13.098,94			Subtotal Orçado R\$ 14.3560	14,3560	R\$ 2.296,28
									15,99522	%

https://o7n78tempq8.kbuofont.net/relatorio/pregao/64445/relatorio_pregao_homologado_completo_67357645433.html

1/9

19/06/2023, 10:06

LICITANET - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ., %	Economia R\$
17	5,00	UN	belitz	belitz	R\$ 49,90	R\$ 249,50	R\$ 61,99	R\$ 309,95	19,50	R\$ 12,99
Descrição: ESCOVA VAZADA TERNICA 80 MM REDONDA CERDAS EM NYLON										
18	5,00	UN	belitz	belitz	R\$ 54,80	R\$ 274,00	R\$ 84,31	R\$ 421,55	30,00	R\$ 29,51
Descrição: ESCOVA VAZADA TERNICA 72 MM REDONDA CERDAS EM NYLON										
19	50,00	UN	Bella Chick	Bella chick	R\$ 4,43	R\$ 221,50	R\$ 4,43	R\$ 221,50	0,00	R\$ 0,00
Descrição: ESMALTE CREMOSO DE CORES VARIADAS, COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO.										
20	50,00	UN	Bella Chick	Bella Chick	R\$ 4,22	R\$ 211,00	R\$ 4,22	R\$ 211,00	0,00	R\$ 0,00
					Subtotal Adjudicado R\$ 13.098,94			Subtotal Orçado R\$ 14.3560	14,3560	R\$ 2.296,28
									15,99522	%

https://o7n78tempq8.kbuofont.net/relatorio/pregao/64445/relatorio_pregao_homologado_completo_67357645433.html

2/9



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã - MG 19 de Junho de 2023.

19/06/2023, 10:06 LICITANET - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
80	5,00	RL	PERFAN	FD 40	RS 413,00	RS 3.501,00	RS 612,23	RS 3.061,15	0,38	RS 2,23
Descrição: TECIDO POLIESTER 100% ALGODÃO 1,40 DE LARGURA CONTENDO 50 METROS										
81	14,00	RL	OVER	LBDO	RS 193,00	RS 4.340,00	RS 375,50	RS 5.257,00	17,44	RS 65,50
Descrição: TECIDO SACARIF PARA PANO DE PRATO COM 70 CM. CONTENDO 50 METROS.										
82	1.200,00	M	STARFE	GRAM 30	RS 1,30	RS 1.560,00	RS 4,70	RS 72,34	RS 3,40	RS 6,40
Descrição: TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO COM LARGURA MÍNIMA 1,40 METROS, COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO.										
84	1.000,00	M	MEIVI	FD 30	RS 11,00	RS 11.000,00	RS 28,20	RS 43.600,00	RS 62,33	RS 18,20
Descrição: TECIDO TROCOLINE LINO 67% POLIESTER 28% ALGODÃO E 5% ELASTANO, 1,60 DE LARGURA, COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO.										
85	300,00	M	DEL'PA	MICROTULE	RS 2,50	RS 750,00	RS 7,65	RS 2.295,00	RS 67,32	RS 5,15
Descrição: TECIDO TULE COM NO MÍNIMO 1,40 METROS DE LARGURA, COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO.										
86	100,00	M	ESTIOTEX	VAGONITE	RS 23,00	RS 2.300,00	RS 40,90	RS 4.090,00	RS 43,77	RS 17,90
Descrição: TECIDO VAGONITE COR BRANCA.										
87	500,00	M	FERNANDO MALH	FD 30	RS 16,00	RS 8.000,00	RS 37,67	RS 18.635,00	RS 57,53	RS 21,67
Descrição: TECIDO KADREZ 100% ALGODÃO 0,50 X 1,30 CM. COR DEFINIR NO ATO DO PEDIDO										
88	500,00	UN	SOUZA	PNOS	RS 16,00	RS 8.000,00	RS 87,50	RS 43.750,00	RS 78,32	RS 51,56
Descrição: TELA PARA PINTURA 100% ALGODÃO 40 X 60 CM. COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO BIPHARMADA COM RESINA PVA BRANCO NEVE, EM MADEIRA FINOS.										
89	200,00	UN	SOUZA	PNOS	RS 32,00	RS 6.400,00	RS 77,28	RS 15.456,00	RS 58,59	RS 45,28
Descrição: TELA PARA PINTURA 100% ALGODÃO 60 X 90 CM COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO BIPHOS, BIPHARMADA COM RESINA PVA BRANCO NEVE, EM MADEIRA FINOS.										
94	1.200,00	UN	ACRILEX	P. TECIDO	RS 2,90	RS 3.480,00	RS 4,74	RS 5.688,00	RS 38,82	RS 1,84
Descrição: TINTA PARA TECIDO 37 ML. COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO										
95	2.000,00	UN	ACRILEX	PVA	RS 6,90	RS 13.800,00	RS 15,50	RS 31.000,00	RS 55,48	RS 8,60
Descrição: TINTA PVA FOSCA 100 ML. COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO										
					Subtotal Adjudicado R\$ 201.060,90		Subtotal Orçado R\$ 426.178,59		52,8196 %	RS 225.107,69

https://sv/7n78mpqd8.cksoffort.net/reports/prego64445relativov_pregos_homologados_completo_67357645433.html 7/0

19/06/2023, 10:06 LICITANET - Termo de Homologação

Fornecedor: SUPER COMERCIAL APOLO LTDA - 18.343.089/0001-54

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
26	100,00	RL	RABO D SOL	50X50CM	RS 1,80	RS 180,00	RS 8,82	RS 882,00	78,82	RS 7,12
Descrição: PPELHO LISO 08 MM X 30 M COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO										
39	20,00	CK	TALGE	G	RS 20,00	RS 520,00	RS 36,75	RS 735,00	34,56	RS 13,75
Descrição: LUMPA DE VINIL HIPOALERGÊNICA TAMAHO G COM AMBID BIABSORVIVEL INCOLOR DESCARTAVEL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.										
40	20,00	CK	TALGE	M	RS 20,00	RS 520,00	RS 44,58	RS 891,60	41,68	RS 18,58
Descrição: LUMPA DE VINIL HIPOALERGÊNICA TAMAHO M COM AMBID BIABSORVIVEL INCOLOR DESCARTAVEL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.										
41	20,00	CK	TALGE	P	RS 20,00	RS 520,00	RS 31,25	RS 625,00	16,80	RS 5,25
Descrição: LUMPA DE VINIL HIPOALERGÊNICA TAMAHO P COM AMBID BIABSORVIVEL INCOLOR DESCARTAVEL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.										
48	10,00	UN	PLAVITEC	45CMX10M	RS 88,00	RS 880,00	RS 98,58	RS 985,80	31,30	RS 30,98
Descrição: PAPEL ADESIVO CONTACT 45 CM X 10 M COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO.										
49	80,00	UN	SUZANO	86X60	RS 7,00	RS 560,00	RS 23,10	RS 1.848,00	69,79	RS 16,10
Descrição: PAPEL COLOR PLUS 120 GRAMAS 60X90CM. COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO										
64	231,00	RL	ESTIOTEX	1,6MT	RS 1.843,71	RS 423.897,01	RS 1.548,32	RS 425.850,32	RS 6,00	RS 6,01
Descrição: TECIDO ATUALHAADO 100% ALGODÃO, COM 1,40 METROS DE LARGURA, NA COR BRANCA, CONTENDO 50 METROS.										
65	1.000,00	M	ESTIOTEX	1,6MT	RS 39,79	RS 39.790,00	RS 40,95	RS 40.950,00	RS 3,05	RS 1,25
Descrição: TECIDO BRM LENO 100% POLIESTER COR LISLA ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.										
76	500,00	M	FIDISUL	95% POLIESTER 5% VISCOSE	RS 21,90	RS 10.950,00	RS 44,90	RS 22.450,00	RS 51,22	RS 23,00
Descrição: TECIDO MALHA PV 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO.										
77	200,00	M	ESTIOTEX	1,6MT	RS 8,80	RS 1.760,00	RS 11,93	RS 2.386,00	27,91	RS 3,33
Descrição: TECIDO ORGANZA CRISTAL COM NO MÍNIMO 1,50 METROS DE LARGURA, COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO										
79	500,00	UN	ESTIOTEX	2,4MT	RS 26,85	RS 13.425,00	RS 56,63	RS 28.315,00	RS 52,99	RS 28,78
Descrição: TECIDO PARA COBERTOR MICRO FIBRA 100% POLIESTER COR LISLA ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.										
83	500,00	M	ESTIOTEX	1,6MT	RS 16,20	RS 8.100,00	RS 27,45	RS 13.725,00	RS 40,62	RS 11,15
					Subtotal Adjudicado R\$ 506.462,01		Subtotal Orçado R\$ 546.220,72		7,2868 %	RS 38.818,71

https://sv/7n78mpqd8.cksoffort.net/reports/prego64445relativov_pregos_homologados_completo_67357645433.html 8/0

19/06/2023, 10:06 LICITANET - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
Descrição: TECIDO TROCOLINE ESTAMPADO 67% POLIESTER 28%ALGODÃO E 5% ELASTANO, 1,60 DE LARGURA, COR A DEFINIR NOATO DO PEDIDO.										
97	200,00	UN	ACRILEX	250ML	RS 17,90	RS 3.580,00	RS 32,37	RS 6.474,00	44,53	RS 14,37
Descrição: VERNIZ ACRILICO BRILHANTE PARA ARTESANATO, EMBALAGEM COM 250 ML.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 508.462,01		Subtotal Orçado R\$ 946.220,72		53,7388 %	RS 38.818,71

Fornecedor: D'PAULA LICITAÇÕES LTDA - 31.604.207/0001-07

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
51	5,00	UN	ESACARE	Bolonic	RS 2,50	RS 12,50	RS 2,50	RS 12,50	0,00	RS 0,00
Descrição: PENTE FINO DE PLÁSTICO, PARA PENCAO DE FOLHAS E LENÇAS.										
63	40,00	UN	ESACARE	400H	RS 30,88	RS 1.235,20	RS 30,88	RS 1.234,40	0,00	RS 0,80
Descrição: SPRAY FIOADOR CAPLAIF 400 ML.										
98	4,00	RL	HAPER	1,40X30MT	RS 276,01	RS 1.104,04	RS 335,03	RS 2.140,12	49,53	RS 265,82
Descrição: TOALHA DE MESA TERMICA PLÁSTICA 1,40 M LARGURA, CONTENDO 30 METROS, COR A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 2.326,94		Subtotal Orçado R\$ 3.379,02		31,2963 %	RS 1.058,08

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 723.896,79	R\$ 991.773,55	27,0602 %	268.276,76

HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
Araporã-MG, 19 de Junho de 2023

CELSO ROMULO GUERINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

https://sv/7n78mpqd8.cksoffort.net/reports/prego64445relativov_pregos_homologados_completo_67357645433.html 9/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA N° 58, CENTRO - ARAPORÃ/MG - 38.465-000
TEL: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORÃ.MG.GOV.BR

PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2023
MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2023 - REGISTRO DE PREÇOS para EVENTUAL e FUTURA aquisição de GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P/BOTIJÃO P13(REFIL) E CILINDROS TIPO P13 COM CARGA, destinados a manutenção de diversas secretarias e órgãos pertencentes ao MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela proçeoira Oficial, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico favorável à homologação, **RESOLVO**, no uso de minutas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4º, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de **Pregão Presencial nº 036/2023**, objetivando, **REGISTRO DE PREÇOS** para **EVENTUAL e FUTURA** aquisição de **GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P/BOTIJÃO P13(REFIL) e CILINDROS TIPO P13 COM CARGA**, destinados a manutenção de diversas secretarias e órgãos pertencentes ao **MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG**, apresentando-se como proposta mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s), vencedora dos itens abaixo relacionados:

- **VILSON LOURENCO DE OLIVEIRA**, regularmente inscrita no CNPJ nº 05.433.902.0001-35, já declarada **HABILITADA** por atender todas as exigências documentais editalícias **VENCEDORA** nos **ITENS 01 e 02** por apresentar o menor preço unitário dentro do estimado, perfazendo um **VALOR GLOBAL DE PROPOSTA de R\$ 29.978,00 (vinte e nove mil novecentos e setenta e oito reais)**, nos valores unitários registrados no mapa de apuração em anexo.

Importa-se o presente Pregão na importância total de **R\$ 29.978,00 (vinte e nove mil novecentos e setenta e oito reais)**

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ aos 19 de junho de 2023.

Celso Romildo Guerinio
Secretário Municipal de Administração



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA N° 58, CENTRO - ARAPORÃ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORÃ.MG.GOV.BR

ATA DE CREDENCIAMENTO nº 002/2023

1ª SESSÃO PÚBLICA

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2023, às 13h:00m (treze horas), com quinze (15) minutos de tolerância, os membros da Comissão Permanente de Licitações do Município de Araporã/MG nomeada pelo Decreto Municipal nº 5.243/2023 de 02/05/2023 reuniram-se na sala de reuniões, Sra. JAQUELINE INÁCIO ALVES FERREIRA, Sr. EMERSON TIZZO e a Sra. ELIZANDRA BORGES DE LIMA, sob a presidência da primeira, para realizar PRIMEIRA SESSÃO PÚBLICA para receber, apreciar, analisar e julgar os envelopes protocolados até a presente data, contendo DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS do CREDENCIAMENTO Nº 002/2023, cujo objeto trata do CREDENCIAMENTO, em caráter permanente, de serviços profissionalizantes hospitalares na área da saúde, para o Hospital Municipal João Paulo II e demais unidades que compõem o SISTEMA DE SAÚDE do Município de Araporã/MG, tendo como data final de credenciamento de novos interessados 13/06/2024. O aviso do edital foi regularmente publicado, na forma da Lei, no site oficial do Município e no Diário Oficial do Município em 12/06/2023, no Diário Oficial da União em 13/06/2023, convocando todos os interessados e tornando público a abertura de prazo de recebimento de documentos de profissionais liberais e pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde. Na data e horário aprazados para a 1ª sessão pública foram analisados os documentos dos profissionais e empresas protocolados, sendo eles(s): a Pessoa Física BRUNA KELLY NETO SANTOS, enfermeira, CPF: 087.374.038-05, com endereço a Avenida Umuarama, apt° 1003, Bairro Umuarama, na cidade de Uberlândia/MG, credenciamento assinado de próprio punho, documentos apresentados sem portador credenciado e protocolados na data de 16/06/2023, NÃO apresentou Termo de Renúncia EXPRESSA quanto aos prazos recursais legais, a Pessoa Física LIDIANA LEITE GUIMARÃES DINIZ, enfermeira, CPF: 064.995.166-27, com endereço a Rua Professor Osvaldo B. Oliveira, nº 858, Od. 28, Lt. B, Bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Rumbiará/MG, credenciamento assinado de próprio punho, documentos apresentados sem portador credenciado e protocolados na data de 16/06/2023, apresentou Termo de Renúncia EXPRESSA quanto aos prazos recursais legais. Finalizado o registro dos credenciados, analisada e rubricada toda documentação pelos presentes, os membros da Comissão Permanente de Licitações na presença de todos e por unanimidade, através de sorteio, classificaram o(s) credenciado(s) na presente sessão de Credenciamento nº 002/2023, ficando assim registrada a classificação:

ITEM	ESPECIALIDADE	LOCAL DE ATUAÇÃO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
1	ENFERMEIRO PADRÃO	HOSPITAL JOÃO PAULO II	1ª - LIDIANA LEITE GUIMARÃES DINIZ 2ª - BRUNA KELLY NETO SANTOS
2	PEDIATRA	PSF's	*****
3	PEDIATRIA/NEONAT AL	HOSPITAL JOÃO PAULO II	*****
4	PEDIATRIA/NEONAT AL	HOSPITAL JOÃO PAULO II	*****
5	PEDIATRIA/NEONAT AL	HOSPITAL JOÃO PAULO II	*****
6	PSIQUIATRA	HOSPITAL JOÃO PAULO II	*****
7	OPHTALMOLOGISTA	CLÍNICA PARTICULAR	*****
8	OPHTALMOLOGISTA	CLÍNICA PARTICULAR	*****
9	OPHTALMOLOGISTA	HOSPITAL JOÃO PAULO II	*****
10	OPHTALMOLOGISTA	HOSPITAL JOÃO PAULO II	*****
11	OPHTALMOLOGISTA	HOSPITAL JOÃO PAULO II	*****
12	SERVIÇOS DE	HOSPITAL PARTICULAR	*****

Divisão de Licitação e Contratos - Rua José Inácio Ferreira, 58 - Araporã/MG - CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 - licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA N° 58, CENTRO - ARAPORÃ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORÃ.MG.GOV.BR

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
13	UROLOGISTA	CONSULTÓRIO PARTICULAR	*****
14	UROLOGISTA	HOSPITAL JOÃO PAULO II	*****
15	UROLOGISTA	CONSULTÓRIO PARTICULAR	*****
16	UROLOGISTA	HOSPITAL JOÃO PAULO II	*****
17	UROLOGISTA	HOSPITAL JOÃO PAULO II	*****
18	UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	CLÍNICA PARTICULAR	*****
19	CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO	CLÍNICA PARTICULAR	*****
20	CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO	CLÍNICA PARTICULAR	*****
21	CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO	CLÍNICA PARTICULAR	*****
22	CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO	CLÍNICA PARTICULAR	*****
23	CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO	CLÍNICA PARTICULAR	*****
24	CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO	CLÍNICA PARTICULAR	*****
25	CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO	CLÍNICA PARTICULAR	*****
26	CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO	CLÍNICA PARTICULAR	*****
27	CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO	CLÍNICA PARTICULAR	*****
28	ENFERMEIRO	PSF	1ª - LIDIANA LEITE GUIMARÃES DINIZ 2ª - BRUNA KELLY NETO SANTOS

Divisão de Licitação e Contratos - Rua José Inácio Ferreira, 58 - Araporã/MG - CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 - licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA N° 58, CENTRO - ARAPORÃ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORÃ.MG.GOV.BR

29	PSIQUIATRA	PSF	*****
----	------------	-----	-------

Nada mais havendo a ser tratado, abre-se o prazo recursal e encerra-se a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes e membros da Comissão Permanente de Licitações.

Jaqueline Inácio Alves Ferreira
Presidente da CPL

Elizandra Borges de Lima
Membro da CPL

Emerson Tizzo
Membro da CPL

Divisão de Licitação e Contratos - Rua José Inácio Ferreira, 58 - Araporã/MG - CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 - licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA N° 58, CENTRO - ARAPORÃ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORÃ.MG.GOV.BR

Processo Licitatório nº. 063/2023 Araporã/MG, 19 de Junho de 2023.
Pregão Eletrônico n. 018/2023

Assunto: RESPOSTA AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS PELAS EMPRESAS KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA e INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA.

Trata o presente processo de recursos interpostos pelas recorrentes da decisão que a julgou INABILITADA no certame público do PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/2023, cujo objeto trata da aquisição de 01(uma) MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, cujos recursos são oriundos do PAJ n. 000312.2016.03.001/2 firmado entre o Município de Araporã e a Procuradoria do Trabalho - Tribunal Regional do trabalho 3ª região de Minas Gerais.

1. Registre-se primeiramente que duas empresas apresentaram recursos quanto sua desclassificação, sendo elas, KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA e INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, como os motivos e alegações apresentados pelas empresas são "idênticos", responderemos em uma única peça.

2. A sessão pública de abertura e julgamento do referido Pregão teve início dia 24 de maio de 2023 às 13h:30m, a qual, no final ficou estabelecido o seguinte julgamento: "...Fornecedor: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, com lance no valor de R\$ 85.000,00, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: O equipamento ofertado não atende o descritivo do Edital, não possui Dorso segmentado e removível..." (grifo nosso).

Divisão de Licitação e Contratos - Rua José Inácio Ferreira, 58 - Araporã/MG - CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 - licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA Nº 88, CENTRO - ARAPORÃ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORã.MG.GOV.BR

2

3. Registre-se ainda que, as Recorrentes KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA e INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA protocolaram tempestivamente suas peças recursais, nas datas de 01/06/2023 e 02/06/2023, sendo as mesmas recebidas e publicadas na plataforma licitnet, identificando as demais empresas licitantes para querendo se manifestarem, onde a empresa BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA apresentou, tempestivamente, contrarrazões aos recursos oferecidos pelas empresas KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA e INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA na data de 07/06/2023;

4. Insurgem-se contra a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio declarando, em apertada síntese, principalmente que:

4.1. As recorrentes alegam que foram consideradas desclassificadas no item 01 – MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA injustamente, pois o modelo cotado por ambas empresas não atende as descrições previstas em edital (não possui Dorsos segmentado e removível).

4.2. Alegam também que houve direcionamento, pois a característica seria própria de um fabricante e que no caso foi empresa vencedora no citado item 01 – MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, afirmando que somente aquela marca possui dorso segmentado e que é uma característica utilizada em procedimentos cirúrgicos renais.

5. A empresa BARRFAB alega em suas Contrarrazões que cumpre todo o descritivo do item solicitado em edital, alegando ser o recurso utilizado meramente para perturbar o procedimento licitatório.

6. A contrarrazoante alega também que o dorso bipartido não é característica direcionada, nem para fabricantes e nem para movimentos renais, e apresenta diversas marcas que atendem o descritivo do edital (SISMATEC, ORTOSINTES, MINDRAY, BARRFAB E DRAEGER).

Diretoria de Compras e Licitações - Rua José Inácio Ferreira, 88 - Araporã/MG - CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 - licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA Nº 88, CENTRO - ARAPORã/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORã.MG.GOV.BR

Requerem as recorrentes KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA e INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA a reconsideração da decisão desta Pregoeira e Equipe de Apoio fatos e fundamentos que trazem em suas peças recursais.

Requer a empresa contrarrazoante a improcedência do recurso administrativo e manutenção integral da decisão aqui examinada.

Isto posto, esta Pregoeira, que ao final subscreve, balizando-se nos preceitos legais e nas informações trazidas pelo Setor Técnico do Hospital Municipal João Paulo II decide pelo seguinte julgamento.

DA ANÁLISE DO MÉRITO

As Recorrentes iniciam suas alegações SUPONDO sua ilegal DESCLASSIFICAÇÃO no item 01 – MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, alegando que atenderam todos os requisitos do edital, e que houve equívoco na decisão da Pregoeira e da Equipe de Apoio.

Outro ponto apresentado pelas Recorrentes é que o edital foi direcionado para uma única empresa fabricante, alegando que o município queria adquirir daquela determinada empresa e por valor maior. Alegam também que a funcionalidade da mesa é direcionada a procedimentos cirúrgicos renais.

Em contrarrazões, a empresa BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA impugna as alegações das recorrentes, explicando que o dorso bipartido não é característica destinada a cirurgias renais, e tem a funcionalidade de permitir que a seção do dorso seja removida com a cabeceira para inversão do paciente, além da colocação dos acessórios, como por exemplo tripartido de ombro e outros, aumentando a funcionalidade da mesma. Apresenta também várias empresas (SISMATEC, ORTOSINTES, MINDRAY, BARRFAB E DRAEGER) que possuem mesas cirúrgicas elétricas que atendem as condições do edital.

Diretoria de Compras e Licitações - Rua José Inácio Ferreira, 88 - Araporã/MG - CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 - licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORã-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA Nº 88, CENTRO - ARAPORã/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORã.MG.GOV.BR

4

ULTRAPASSADAS AS ALEGAÇÕES, VAMOS AOS FATOS!

Qualquer alegação quanto a direcionamento de edital para marca/modelo específico, deveria ser motivo de impugnação do edital, porém único questionamento apresentado pela empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA, sequer mencionou o "direcionamento" alegado neste recurso. E mais, em sua peça impugnatória alegou que "A licitação é o instrumento de seleção que a Administração Pública se utiliza, objetivando obter a proposta mais vantajosa aos seus interesses. É certo que o sentido de "vantajosa" não é sinônimo de mais econômica financeiramente, já que, a licitação busca selecionar o contratante e a proposta que apresentem as melhores condições de atender o reclamos do interesse coletivo, tendo em vista todas as circunstâncias previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade etc)"(sic).

Para melhor esclarecer e fundamentar a resposta, a pregoeira e sua equipe de apoio, solicitou da equipe técnica do hospital informação da existência de marcas de mesas cirúrgicas que atendam o descritivo do edital e, qual a necessidade de o município adquirir mesa cirúrgica com Dorso Bipartido e Removível, conforme consta no Termo de Referência.

Em resposta, enviaram 03(três) modelos de mesa cirúrgica de marcas distintas da empresa habilitada e que também atendem ao descritivo do edital. Folders/Descritivos em anexo.

Quanto a necessidade da aquisição de mesa cirúrgica com dorso bipartido e removível, nos encaminhou uma foto da posição de um paciente em uma cirurgia renal, onde fica demonstrado, primeiramente que, para a cirurgia renal não é necessário a utilização de mesa com dorso bipartido. Essa característica se faz necessária simplesmente para aumentar a funcionalidade da mesa, facilitando a ação dos profissionais que se encontram na sala cirúrgica. Vejamos abaixo:

Diretoria de Compras e Licitações - Rua José Inácio Ferreira, 88 - Araporã/MG - CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 - licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORã-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA Nº 88, CENTRO - ARAPORã/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORã.MG.GOV.BR



Esta imagem mostra o paciente em posição para cirurgia renal e o dorso não precisa ser bipartido para o procedimento.
A função do dorso bipartido ou até mesmo ou segmento que não seja o dorso é aumentar a funcionalidade da mesa facilitando a ação dos profissionais que estão na sala cirúrgica.

Em momento algum no descritivo da mesa cirúrgica constante no edital, menciona que a mesma seria utilizada especificamente para cirurgias renais e sim para "PROCEDIMENTO CIRÚRGICO GERAL E ORTOPEDIA", ou seja, deve atender todos os tipos de demandas cirúrgicas do hospital municipal.

Não restando dúvida sobre a correta DESCLASSIFICAÇÃO das reclamantes KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA e INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, e da correta classificação da proposta ofertada pela empresa classificada BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, e, em acordo com a resposta enviada pela própria fabricante da marca apresentada pelas duas empresas, passamos a conclusão.

DA CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,

Em homenagem aos princípios constitucionais e às regras constantes no Estatuto de Licitações, tem-se por plenamente LEGAL e justificada a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio quanto à DESCLASSIFICAÇÃO no item 01 – MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA da

Diretoria de Compras e Licitações - Rua José Inácio Ferreira, 88 - Araporã/MG - CEP 38.465-000
Fone: (34) 3284-9516 - licitacao@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA N° 86, CENTRO - ARAPORÃ-MG - 38.485-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORã.MG.GOV.BR

empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA e INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA no Pregão n. 018/2023 e manutenção da decisão que consta na Ata de Abertura e Julgamento do Pregão n.018/2023;

Considerando que a decisão da Pregoeira pela DECLASSIFICAÇÃO das ora Recorrentes está baseada em robusta e conhecida legislação, bem como nos termos do Edital do Pregão, esta Pregoeira Oficial e respectiva Equipe de Apoio julga TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos dos recursos oferecidos pelas empresas KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA e INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, decidindo pela manutenção da DECLASSIFICAÇÃO NO ITEM 01 - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA e CLASSIFICAÇÃO da empresa contrarrazoante BARRAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA no certame em epígrafe e pelo prosseguimento normal do feto.

Registre-se e publique-se.

Encaminhe-se a presente decisão à autoridade superior para considerações que julgar pertinentes, nos termos do § 4º do Art. 109 da Lei Federal n. 8.666/93.

Araporã/MG, 16 de Junho de 2023.


Cristiane Fagundes Queiroz Soares
Pregoeira Oficial

Diário de Notícias e Notícias - Rua José Inácio Ferreira, 86 - Araporã-MG - CEP 38.485-000
Fone: (34) 3284-9500 - E-mail: diario@arapora.mg.gov.br - www.arapora.mg.gov.br

HOME | [Araporã \(arapora.mg.gov.br\)](#) | [Mesa Hospitalar Eletro-Hidráulica \(intensimed.com.br\)](#)
| [Cama Hospitalar Eletro-Hidráulica \(intensimed.com.br\)](#)



Compartilhe <https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fintensimed.com.br%2Fmesa/>
[https://twitter.com/intent/tweet?](https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A%2F%2Fintensimed.com.br%2Fmesa/)
<https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fintensimed.com.br%2Fmesa/> (mailto: suporte@intensimed.com.br)

Mesa Cirúrgica Universal Eletro-Hidráulica, MI-3500EH
suporte@intensimed.com.br
<https://www.intensimed.com.br/>

Adicionar a Cotação

Descrição de Mesa Cirúrgica Universal Eletro-hidráulica, MI-3500EH

Mesa Cirúrgica Universal Eletro-hidráulica, MI-3500EH

A Mesa Cirúrgica Universal MI-3500EH é um produto desenvolvido com finalidade de permitir grande diversidade de procedimentos cirúrgicos. O sistema de funcionamento da Mesa Cirúrgica MI-3500EH é eletro-hidráulico, sendo que seu acionamento é efetuado através de controle remoto com fio e painel de controle localizado na coluna da mesa, também pode-se usar o controle remoto sem fio como opcional.

Base e Coluna: Confeccionadas em chapa de aço com acabamento pintado em KTL e revestido com aço inoxidável. Possui painel de controle na coluna para acionamento eletrônico das movimentações. A coluna possui reposicionador sem chapa metálica de aço que evita o acúmulo de gordura.

Chassi: Blindado oferecendo maior resistência à mesa, confeccionado em chapa de aço inoxidável com acabamento escovado.

Tampo: Confeccionado em material rígido transparente montado sobre estrutura de aço inoxidável, permitindo a visualização do interior do raio X. Dividido em 6 seções: cabeceira, duas seções de dorso, assento, prolongador de pernas e seção de pernas ajustáveis, inclui regulagem lateral em aço inoxidável com corrediças para montagem de acessórios.

Rodas: Duas rodas de 7" de diâmetro com freio e uma roda de 8" de diâmetro com sistema de travamento, acionadas por controle remoto com fio permitindo a mobilização da mesa sobre o solo. Este sistema de rodas, permite um fácil deslocamento do produto.

Estofados: Estofados divididos em 6 seções, confeccionados com espuma viscoelástica com dupla camada: 1ª camada espuma visco elástica densidade 160, 2ª camada com espuma densidade 45, proporcionando comodidade ao paciente.
O modelo é revestido com bimatel.

Movimentos: Da movimentação de Ajuste de Altura, Inclinação Lateral, Trendelenburg, Reverso de Trendelenburg, Dorso, Complacimento das Pernas são efetuados através de jacks hidráulicos comandados eletronicamente através de controle remoto com fio. Painel de controle localizada na coluna e controle remoto sem fio opcional. Os movimentos de Cabeça, Braço e Pernas são efetuados manualmente por sistema pneumático, acionados por alavancas. O movimento de trava das rodas é acionado através do motor elétrico. Equipada com bateria que permite sua utilização na falta de energia elétrica, realizando aproximadamente 70 movimentos.

Accessórios que acompanham o Produto:
Par de Rodas de Traseira AC-300103
Arco de Nervos AC-300111
Par de Ondulinas Revestido de Espuma AC-300106
Realizador Realiz em Inox AC-300119 (opcional)
Par de Porta-Costas AC-302109
Conjunto Estofados com 6 Seções em Viscoelástico com Capa em Bimatel AC-300016
Controle Remoto com Fio - PC-350195H1

Assessoria Não Incluída:
Conjunta de Tampa em Fibras de Carbono AC-350008
Ferramenta Lufax AC-350008
Tubo Ortopédico Adaptável AC-350004
Barrileta Porta-Cabeça para Raio X AC-350005
Cabeceira Ajustável AC-350006
Suporte Fixo com Raios de Fluor Escudo AC-350007
Assessoria para Cirurgia de Dorso Tripartido AC-350008
Suporte de Pernas com Raios de Fluor Escudo AC-350009
Par de Superfície Lateral Realiz AC-350011

Quem cotou esse produto, cotou também



(m-0650-ho-escada-em-aco-inox.html)
RM-0650-HO Escada em Aço Inox (m-0650-ho-escada-em-aco-inox.html)
RENOVAR MÓDULO

Adicionar a Cotação





(cama-fowler-com-4-motores-e-controle-digital-rm-489.html)
CAMA FOWLER COM 4 MOTORES, E CONTROLE DIGITAL, RM-489 (cama-fowler-com-4-motores-e-controle-digital-rm-489.html)
RENOVAR MÓDULO

Adicionar a Cotação

MESA CIRÚRGICA MASTERTEC 15 ELETRO-HIDRÁULICA BARIÁTRICA

A mesa cirúrgica Mastertec 15 Eletro-Hidráulica Bariátrica, foi desenvolvida para atender todas as especialidades cirúrgicas de pequeno, médio e grande porte, permitindo ao cirurgião posicionar o paciente de acordo com a capacidade da cama e seu sistema de elevação que posiciona a mesa cirúrgica a apenas 630 mm do solo permite posicionamento ergonomicamente correto e seguro a equipe médica durante as cirurgias de grande porte. Possui sistema de travamento que evita o acúmulo de gordura, projetado, fabricado e certificado conforme requisitos das normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46.

Categorias: Catálogo de Vendas (<https://gob.com.br/categoria-produto/catalogo-de-vendas/>), Eletro-Hidráulica (<https://gob.com.br/categoria-produto/catalogo-de-vendas/eletro-hidraulica/>), Equipamentos Médicos (<https://gob.com.br/categoria-produto/catalogo-de-vendas/equipamentos-medicos/>), Mesa Cirúrgica (<https://gob.com.br/categoria-produto/catalogo-de-vendas/mesa-cirurgica/>), Sistema de Vendas (<https://gob.com.br/categoria-produto/catalogo-de-vendas/sistema-de-vendas/>)
Tags: (<https://gob.com.br/produto-tag/150/>), Bariátrica (<https://gob.com.br/produto-tag/151/>), Cirúrgica (<https://gob.com.br/produto-tag/152/>), Eletro-Hidráulica (<https://gob.com.br/produto-tag/153/>), Mastertec (<https://gob.com.br/produto-tag/154/>), Mesa (<https://gob.com.br/produto-tag/155/>)

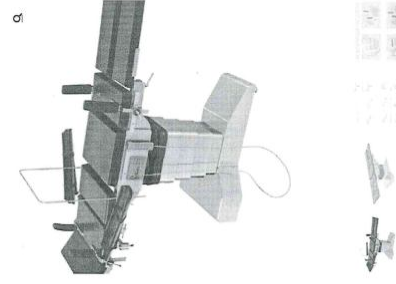

© SEMAR - Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução ou distribuição não autorizada sem o consentimento escrito da SEMAR. (011) 3160-4270



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

RECEITAÇÃO	MARCA	AVALIAÇÃO(03)
------------	-------	---------------

Descrição

Características Gerais:




- A mesa cirúrgica Masterec 15 atende as exigências da PORTARIA Nº 492 DE 31 DE AGOSTO DE 2007, que determina a operacionalização de procedimentos cirúrgicos em salas de cirurgia, com mesa cirúrgica elétrica com elevador hidráulico que resista a pesos superiores a 300 kg.
- O modelo Bariatrico oferece como diferencial a movimentação da superfície da mesa a uma altura menor que os demais modelos (63 cm).
- Equipamento de fácil limpeza, pois possui tempos removíveis e que diminui significativamente o tempo de limpeza.
- Sua base em forma de "T" proporciona ao equipamento grande estabilidade.
- Os movimentos cirúrgicos, proporcionam ainda condições facilitadas para acesso dos componentes que entram em contato com o paciente.
- Equipamento extremamente versátil que atende aos mais variados tipos de especialidades.
- Acabamento em aço inoxidável com pacientes de peso elevado.
- Acabamento em aço inoxidável (fora como opção).
- Movimentação através de pistões hidráulicos, que proporciona ao equipamento grande durabilidade e não ocasiona folga nos movimentos com o desgaste por se tratar de um sistema hidráulico o que não ocorre com os sistemas de fuso (motor elétrico).
- Acionadores Infravermelhos.
- 01 arco de narcole.
- 01 par de porta braço lateral.
- 01 par de porta braço.

Descrição:

- A mesa cirúrgica Masterec 15 é um equipamento de construção robusta, todos os seus movimentos são acionados através de pistões hidráulicos, proporcionando ao equipamento grande durabilidade e precisão no sistema de movimentação.
- Capacidade de carga: 460 Kg.
- Comprimento/Largura Tempo (mm): 2880 x 550.
- Altura: 63 cm (altura base) (mm): 1020 x 390.
- Movimentação/Posições:

Produtos relacionados:

- Preneite subir/baixar 0°-35°/0°-70°.
- Preneite lateral 0°-90°/0°-180°.
- Lateral estender elétrica 0°-20°/0°-20°.
- Elevador cirúrgico de 290 mm.



Medpej

<https://www.medpej.com.br/brand/masterec/>

Características Gerais:

- Capacidade de carga: 460 kg.
- Comprimento/Largura Tempo (mm): 2880 x 550.
- Altura: 63 cm (altura base) (mm): 1020 x 390.
- Movimentação/Posições:

Descrição:

- A mesa cirúrgica Masterec 15 é um equipamento de construção robusta, todos os seus movimentos são acionados através de pistões hidráulicos, proporcionando ao equipamento grande durabilidade e precisão no sistema de movimentação.
- Capacidade de carga: 460 Kg.
- Comprimento/Largura Tempo (mm): 2880 x 550.
- Altura: 63 cm (altura base) (mm): 1020 x 390.
- Movimentação/Posições:

Bloco operatório > Sala de cirurgia > Mesa cirúrgica universal > Inspital Medical Technology

INSPIRAL

Produtos

Mesa cirúrgica universal OT80.25

▼ eletro-hidráulica ▼ com altura regulável ▼ Trendelenburg



Guardar nos favoritos

Artigo vendido por:
Inspital Medical Technology
▼ Alemanha

Qualidade de resposta (17 avaliações)

Este vendedor sempre responde em menos de 48h.

€ Solicitar preços e opções

Pedir orçamento personalizado

Mais informações, veja este anúncio no Inspital Medical Technology

CARACTERÍSTICAS

Aplicações
universal

Acionamento

eletro-hidráulica

Funcionalidades
com altura regulável, Trendelenburg, Trendelenburg reverso, redondelamento, redondelamento

Accessórias
com apoio para pernas

Outras características
em aço inoxidável

Capacidade
360 kg (793.65 lb)

Comprimento
2.200 mm (86.6 in)

Largura
595 mm (23 in)

Altura
MÁX: 1.035 mm (41 in)
MÍN: 595 mm (23 in)

DESCRIÇÃO

O sistema eletro-hidráulico torna esta mesa cirúrgica a mais robusta e durável. OT80.25 pode ser utilizada a diferentes posições, equipada com diferentes acessórios e é adequada para todos os tipos de cirurgia. Esta mesa cirúrgica está equipada com um sistema de inclinação da cabeça que proporciona inclinação 20° (mesas superiores) ou 1° (mesas inferiores). O sistema também possui um sistema de inclinação da base que proporciona inclinação 20° (mesas superiores) ou 1° (mesas inferiores). O sistema também possui um sistema de inclinação da base que proporciona inclinação 20° (mesas superiores) ou 1° (mesas inferiores).

Accessório para mesa cirúrgica

Maneja a estabilidade da mesa cirúrgica com seu elevador rotativo. Integrado à mesa e ajustável até 150° (70 mm).

Função de inclinação

Rotação X transportada em uma ampla gama sem perturbar o ambiente estável pela sua construção de mesa desbalanceada longitudinal de 300 mm.

Desenho funcional

Desenho modular fácil de usar para várias disciplinas cirúrgicas. Corpo cilíndrico e ergonômico em aço inoxidável 316.

Accessórias áreas

As saídas de área em aço inoxidável integradas em ambas as laterais da mesa permitem a fixação de acessórios sem perturbar os acessórios existentes.

Unidade de controle de inclinação

Tempo de mesa livre do manual controlado com alta transparência da mesa X, permitindo a integração de alta qualidade.

Opções de cabeceira: Viseu ou poltrona que garantem o conforto do paciente, aderentes a forma corporal, evitando feridas de pressão.

Accessório para arcos em C

Os arcos em C à mesa de área C e ao tempo da mesa redobrada permitem a integração de alta qualidade. A base da mesa também permite fácil acesso e abas para arcos em C a mesas cirúrgicas. Plano de inclinação opcional do fuso de carbono para integração de 360° disponível.

Tendência automática (ver lista original em inglês)

VIDEO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

CATALOGOS

HOSPITAL

Operating Lights & Operating Tables
52 páginas

Solicitar documentação

Mais informações no site de Hospital Medical Technology: [HMTECH](#)

OUTROS PRODUTOS HOSPITAL MEDICAL TECHNOLOGY

OPERATING TABLES

Ver todos os produtos Hospital Medical Technology

PRODUTOS VISTOS RECENTEMENTE

Exibir todos

Pesquisas relacionadas

Carrinho	Carrinho hospitalar	Carrinho para logística	Carrinho em aço inoxidável	Armário	Carrinho sem gavetas	Carrinho para perna
Carrinho para prevenção de contaminação	Carrinho sem rodas	Armário para hospital	Carrinho para hospital			
Carrinho para dispositivos médicos	Armário de posicionamento	Faixa ortopédica	Carrinho multifuncional	Faixa ortopédica de LED		
Mesa ortopédica	Armário portátil	Armário em aço inoxidável	Carrinho para instrumental			

*Os preços não incluem impostos, transporte, taxa administrativa, nem custos adicionais associados ao envio de produtos e de serviços. Os preços são meramente informativos e podem variar em função das alterações, alterações de especificações ou das taxas de câmbio.

Manual do Operador e Instalação
Mesa Cirúrgica

Modelos: MC357L - 135kg, MC357BL - 250kg e MC357B - 350kg, incluindo todos os opcionais e acessórios.

Mesas Cirúrgicas - V.35 11/2022
NF Registro ANVISA: 10223710128
Aplicação: Suporte e auxílio em cirurgias diversas.

Mensagem aos Operadores do Equipamento

Este manual foi elaborado para apoio ao seu trabalho, descrevendo os procedimentos a serem executados durante a operação e instalação das Mesas Cirúrgicas fabricadas pela Ortosintese Indústria e Comércio Ltda. até a data de sua publicação.

O manual está estruturado em capítulos, estando os itens específicos do sistema reunidos em seus capítulos pertinentes. Cada capítulo descreve um conjunto de informações que seguramente irão auxiliar na execução correta de seu trabalho.

As informações nele contidas representam as últimas disponíveis para o equipamento. Em função da constante preocupação da Ortosintese em oferecer produtos de qualidade e que acompanham o desenvolvimento tecnológico, o produto poderá sofrer atualizações, melhorias e inclusão de novas facilidades com o objetivo de torná-lo mais moderno, eficiente e em linha com o mercado, por isso, esteja atento à data da publicação deste manual.

O objetivo deste manual é que você tenha condições de operar o equipamento adequadamente para mantê-lo em perfeito estado de funcionamento.

Assim, como parceiros que somos, o departamento de pós-vendas da Ortosintese sempre estará à sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Ortosintese Indústria e Comércio Ltda.

Elaborado: Tatiane Nagakura Nere
Revisado: Carlos Alberto Bertasso
Aprovado: Carlos Mascoto Nakamura




DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348


Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

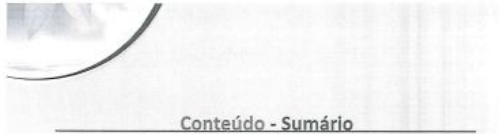

Conteúdo - Sumário

Sumário

Visão Geral do Manual.....	4
Capítulo 1 - Apresentação dos Modelos de Mesas.....	5
Capítulo 2 - Normas e Legislação.....	11
Capítulo 3 - Instruções Sobre Segurança.....	13
Capítulo 4 - Operação.....	18
Capítulo 5 - Módulo de Bateria.....	26
Capítulo 6 - Acessórios.....	27
Capítulo 7 - Manutenção, Limpeza, Transporte e Armazenamento.....	41
Capítulo 8 - Assistência Técnica Autorizada.....	48

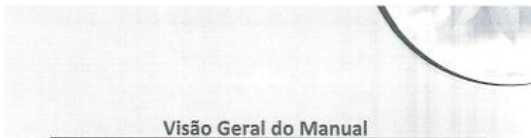

Visão Geral do Manual

A divisão de equipamentos da Ortosintese Indústria e Comércio Ltda., se sente orgulhosa em ter merecido a confiança para fornecer este equipamento.

Temos a convicção de que estamos fornecendo um equipamento de alta tecnologia, que se instalado e operado de forma adequada e, também sendo submetido ao Plano de Manutenção Preventiva descrito neste manual, terá uma vida útil longa, produzindo excelentes resultados.

Para que os equipamentos consigam todo o desempenho para o qual foram projetados, é de vital importância que sejam seguidas todas as orientações contidas neste manual.

Apesar de a responsabilidade de efetuar a manutenção preventiva da máquina não ser do seu operador, cabe a este certificar-se de sua execução, visto que a qualidade de seu trabalho e, em casos extremos, até a sua segurança pode ser comprometida.

A divisão de equipamentos da Ortosintese Indústria e Comércio Ltda., possui uma rede credenciada e treinada para efetuar as revisões necessárias, bem como, coloca-se à disposição de seus clientes para fornecer esclarecimentos e informações que venham a surgir sobre seus produtos.

Este manual se destina a todo o pessoal envolvido na operação das Mesas Cirúrgicas produzidas pela Ortosintese, como médicos, enfermeiros e anestesistas. Antes de operar os equipamentos, o manual deve ser lido atentamente, e os operadores devem ser treinados pelo pessoal da Ortosintese ou um de seus representantes credenciados. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa assistência técnica ou um de nossos representantes.

As mesas cirúrgicas são destinadas a todos os tipos de pacientes, independentemente de suas condições, idade ou saúde, devendo somente ser utilizado o modelo com capacidade para o peso do paciente.

São destinadas e indicadas a uso durante diversos tipos de cirurgias e procedimentos cirúrgicos, tais como Artroscoopia de ombro, Cirurgias Cardiovasculares, Artroscoopia de Joelho, Cirurgias Neurofólicas, entre outros procedimentos.

Como os pacientes estarão deitados sobre as mesas, passando por diversos procedimentos, as mesas entram em contato com todas as partes do corpo dos pacientes.

Ortosintese Indústria e Comércio Ltda.



Capítulo 1 Apresentação das Mesas



Mesa Cirúrgica MC357B - 350Kg - para Cirurgia Geral com Perneira Bipartida.


Movimentos:

Movimento	Mínimo: 780mm (Altura) - Máximo: 1010mm (Altura)
Elevação	650mm
Largura do Leito	25"
Trendelenburg / Procline	25°
Procline	25°
Dorno	+70° / -30°
Lateralidade	+20° / -30°
Elevação Renal	100mm
Perneira	+30° / -90°
Cabeceira	+60° / -70°
Longitudinal	400mm



Capítulo 1 Apresentação das Mesas

Variações do Modelo MC357B - 350Kg:

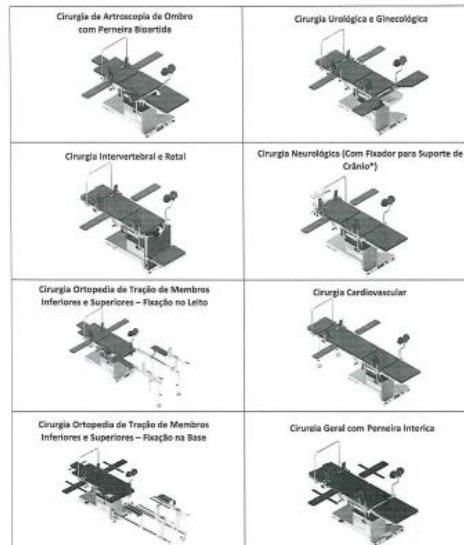

*O suporte de crânio demonstrado no modelo para Neurologia é somente para representação da fixação, e não está incluso na mesa.

**Os acessórios disponíveis em cada modelo de mesa podem ser alterados de acordo com o pedido do cliente.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

Capítulo 2 - Normas e Legislação

As Mesas Cirúrgicas fabricadas pela Ortosintese Indústria e Comércio Ltda., Divisão de equipamentos, são projetadas e fabricadas atendendo as normas e leis que regulamentam este tipo de equipamento. São elas:

- ABNT NBR IEC 60601-1
- ABNT NBR IEC 60601-1-2
- ABNT NBR ISO 14971
- ABNT NBR IEC 60601-2-46
- ABNT NBR IEC 60601-1-6
- ABNT IEC 60601-1-9
- ABNT NBR IEC 62366
- ABNT IEC 62304
- Portaria 384
- ABNT NBR ISO 13485

11

Instruções mostradas em destaque

Atenção: Para indicar que, se um procedimento não for corretamente observado, poderá resultar em ferimentos pessoais e danos ao equipamento, assim como seus acessórios.


Contraindicações de uso: É contraindicado o uso deste equipamento enquanto o mesmo apresente algum tipo de anomalia que possa comprometer o tipo de cirurgia a ser realizada. Este equipamento não deve passar por manutenção ou qualquer tipo de assistência técnica durante a sua utilização ou operação, muito menos durante cirurgias.

Atenção:

Para garantir a segurança dos equipamentos, durante os procedimentos cirúrgicos e utilização geral das mesas devem ser utilizados os Apoios como demonstrado na imagem abaixo, na cabeceira e perneira do equipamento, garantindo assim sua estabilidade e fixação.

Os apoios **NÃO SÃO ACESSÓRIOS OPCIONAIS**, e devem ser utilizados durante a realização de procedimentos das mesas.

Para mais detalhes sobre a conexão de acessórios, veja o "Capítulo 6 - Acessórios".



12

Capítulo 3 Instruções Sobre Segurança

Manter fora do alcance de chuva e umidade em excesso.	Atenção! Consultar os documentos acompanhantes.
Faixa de temperatura para transporte e armazenamento.	Terminal de aterramento de proteção.
Não suspender ou ligar o equipamento, embalado ou não.	220 VOLTS Entrada de energia.
Parte Aplicada tipo B.	Radiação não ionizante.
Lupa/Desliza.	Frágil.
Sentido de transporte/armazenamento.	Empilhamento máximo: duas caixas.
Faixa de pressão atmosférica para transporte e armazenamento.	

13

Capítulo 3 Instruções Sobre Segurança

Adesivo de Identificação do Equipamento



Todas as informações que definem o tipo de equipamento, tensão de trabalho, potência consumida e etc., estão contidas em um adesivo obrigatoriamente fixado na parte frontal do mesmo para facilitar aos técnicos, instaladores e operadores o acesso às informações referentes ao mesmo.

Imagem meramente ilustrativa.
As informações podem variar de acordo com o modelo.

As mesas cirúrgicas da Ortosintese operam com uma faixa de tensão de 110-220VAC, e possuem dois fusíveis de proteção de 3A cada.

Para a troca dos fusíveis, veja o "Capítulo 7 - Manutenção".

Posições Esperadas:

Durante sua utilização normal e correta, as mesas cirúrgicas têm como objetivo suportar pacientes de forma segura e confortável, enquanto auxilia cirurgiões e médicos na movimentação do paciente durante cirurgias.

Por este motivo, é esperado que durante a utilização, o paciente esteja sempre sobre o leito dos equipamentos; durante inclinações e movimentações, o paciente pode admitir diversos posicionamentos diferentes, principalmente em suas pernas, cabeça, pescoço e torso.

Os operadores devem sempre estar próximos do equipamento, de pé a distâncias de no máximo, aproximadamente 1,5 metros; ao executar os movimentos, o operador deve estar atento aos seus próprios membros e do paciente, evitando que estejam a uma distância segura de quaisquer partes móveis. Não é permitido utilizar a base e/ou leito do equipamento como suporte para objetos, ferramentas ou instrumentos.

14



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

Capítulo 3
Instruções Sobre Segurança

ORTOSINTESE

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE E ORIENTAÇÃO – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA

Descrição Técnica:

Características

- Tempo do leito subdividido em 5 seções: cabeceira, dorso, renal, assento e perneira;
- leito confeccionado em fenolite radiotransparente para uso de Raio-X (Parte Casseta) e intensificador de imagem;
- Sistema de freio através de pedal de duplo comando, possuindo dois rodízios giratórios e dois freios, sendo 02 com freio;
- Tensão de entrada: 110-220VAC;
- Tensão de alimentação interna: 33VDC;
- Frequência de alimentação: 50/60Hz;
- Tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I;
- Grau de proteção contra choque elétrico: Parte Aplicada Tipo B;
- Classificação quanto ao uso na presença de anestésicos inaláveis com ar orgânico ou de ódio nitroso: Equipamento não adequado;
- Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX4;
- Modo de operação: contínuo com carga intermitente Ton: 2 min. Toff: 18h 30m;
- Fuente(s) isolada(s) de vólvta 2: 3A;
- Carga máxima de trabalho: MC337L 135kg / MC337R 250kg / MC337B 350kg;
- Consumo em 110V: Subindo 3,37A; Descendo 2,16A; Standby 0,3A;
- Consumo em 220V: Subindo 2A; Descendo 1,4A; Standby 0,08A;

Compatibilidade Eletromagnética

A mesa cirúrgica pode sofrer interferências condutivas e radiadas provenientes de outros equipamentos que compartilham a mesma rede de alimentação ou ambiente. Para evitar riscos, é importante que os equipamentos que compartilham a mesma rede de alimentação ou ambiente sejam aprovados segundo as normas regulamentadoras relacionadas à compatibilidade eletromagnética.

A tabela abaixo possui as declarações a respeito de compatibilidade eletromagnética conforme requisito da norma NBR IEC 60601-1-2:

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE E ORIENTAÇÃO – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS		
As Mesas Cirúrgicas são destinadas a serem utilizadas no ambiente eletromagnético descrito a seguir. O comprador ou operador do equipamento deve se assegurar de que ele está em uso em tal ambiente.		
Emissão de RF IEC 61000-3-3	CISPR 11 – Grupo 1 Classe A	O equipamento é destinado a ser utilizado em ambientes controlados, tais como hospitais, clínicas e ambientes industriais.
Emissão de harmônicas IEC 61000-3-3	Classe A	
Flutuações de tensão e Flicker IEC 61000-3-2	Em conformidade	

Capítulo 3
Instruções Sobre Segurança

ORTOSINTESE

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE E ORIENTAÇÃO – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA

As Mesas Cirúrgicas são destinadas a serem utilizadas no ambiente eletromagnético descrito a seguir. O comprador ou operador do equipamento deve se assegurar de que ele está em uso em tal ambiente.

Ensaio de imunidade	Nível de emissão de IEC 60601-2-13	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Descarga por Contato ±8 kV Descarga pelo Ar ±2 kV, ±4 kV, ±6 kV, ±15 kV	±8 kV - correntado ±15 kV - ar	O piso deverá ser de madeira laminada ou oxidizada. Se o piso é coberto com material sintético, a umidade relativa do ar deverá ser pelo menos 30 %.
Transientes rápidos / Rajadas IEC 61000-4-4	Linhas de Alimentação ±2 kV / 100kHz Linhas de Entrada e Saída de Sinal ±1 kV / 100kHz	±2 kV linhas de alimentação	
Surtos AC (1,2 / 50µs) IEC 61000-4-6	Linhas e terra ±0,5kV a ±1kV	Linhas e terra ±0,5kV a ±1kV	
Quedas de tensão 100% (0%Ur) por 0,5s ciclo nos ângulos de 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°	100% (0% Ur) por 1 ciclo (monofásico a 0°)	100% (0% Ur) por 1 ciclo (monofásico a 0°)	A qualidade da rede elétrica deverá ser aquela de um típico ambiente hospitalar.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão na Alimentação elétrica IEC 61000-4-11	30% (70% Ur) por 25/30 ciclos (monofásico a 0°)	30% (70% Ur) por 25/30 ciclos (monofásico a 0°)	
	Interrupções de Tensão 100% (0% Ur) por 250/300 ciclos	Interrupções de Tensão 100% (0% Ur) por 250/300 ciclos	

Capítulo 3
Instruções Sobre Segurança

ORTOSINTESE

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE E ORIENTAÇÃO – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA

Campos magnéticos das frequências de rede (50/60 Hz) (127/220 V) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Os campos magnéticos das frequências de rede deverão ser níveis característicos de um tipo ambiente hospitalar.
RF Conduzida IEC 61000-4-6	Faixa de Frequência: 150kHz a 30MHz Nível: 3Vrms em toda a faixa e 0Vrms nos bandas ISM entre 0,15 a 0,5MHz. Modulação: AM 80%, 1kHz.	3 Vrms	Equipamentos portáteis e móveis de comunicação por RF não deverão ser usados mais perto (a menos de 30cm) de qualquer parte do equipamento, e nem menos do que a distância de separação recomendada calculada de equação aplicável para a frequência de transmissão. Distância de separação recomendada $d = 1,17 \cdot \sqrt{P}$ $d = 1,17 \cdot \sqrt{P \cdot 80 \text{ MHz} + 800 \text{ MHz}}$ $d = 2,3 \cdot \sqrt{P \cdot 800 \text{ MHz} + 2,0 \text{ GHz}}$ Onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor; e d é a distância de separação recomendada em metros (m). O campo gerado por transmissões de RF fixas, como determinado por um estudo de campo eletromagnético no local, deverá ser menor que o nível de conformidade em cada faixa de frequência. Interferência pode ocorrer nos arredores de equipamentos com o seguinte símbolo:
RF Irradiado IEC 61000-4-3	Faixa de frequência: 80 a 2700MHz Nível: 3V/m Modulação: AM 80%, 1kHz	3 V/m	

NOTA 1: na faixa de 80 MHz e 800 MHz, se aplica a maior frequência de teste.
NOTA 2: esse procedimento pode não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada por obstruções e reflexões de estruturas, objetos e pessoas.
NOTA 3: A instalação de campo gerada por transmissões fixas, tais como estações de rádio base para telefones (cellular/mo) e rádios móveis terrestres, rádios amadores, estações de radiodifusão AM, FM e TV não podem ser facilmente propagadas em ambientes hospitalares. Para evitar o ambiente eletromagnético devido a transmissões de RF fixas, um estudo de campo eletromagnético no local deve ser considerado. Se a intensidade do campo medido no local em que o equipamento é usado exceder o nível de conformidade acima, o equipamento deverá ser desmontado para verificar se está operando normalmente. Se o desempenho anormal é observado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou realocação do equipamento.
NOTA 4: Acima de 80 MHz e 800 MHz, a intensidade de campo deverá ser menor que 3 V/m.

Capítulo 3
Instruções Sobre Segurança

ORTOSINTESE

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE E ORIENTAÇÃO – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS

As Mesas Cirúrgicas são destinadas a serem utilizadas no ambiente eletromagnético descrito a seguir. O comprador ou operador do equipamento deve se assegurar de que ele está em uso em tal ambiente.

Ensaio de imunidade	Nível de emissão de IEC 60601-2-13	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Descarga por Contato ±8 kV Descarga pelo Ar ±2 kV, ±4 kV, ±6 kV, ±15 kV	±8 kV - correntado ±15 kV - ar	O piso deverá ser de madeira laminada ou oxidizada. Se o piso é coberto com material sintético, a umidade relativa do ar deverá ser pelo menos 30 %.
Transientes rápidos / Rajadas IEC 61000-4-4	Linhas de Alimentação ±2 kV / 100kHz Linhas de Entrada e Saída de Sinal ±1 kV / 100kHz	±2 kV linhas de alimentação	
Surtos AC (1,2 / 50µs) IEC 61000-4-6	Linhas e terra ±0,5kV a ±1kV	Linhas e terra ±0,5kV a ±1kV	
Quedas de tensão 100% (0%Ur) por 0,5s ciclo nos ângulos de 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°	100% (0% Ur) por 1 ciclo (monofásico a 0°)	100% (0% Ur) por 1 ciclo (monofásico a 0°)	A qualidade da rede elétrica deverá ser aquela de um típico ambiente hospitalar.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão na Alimentação elétrica IEC 61000-4-11	30% (70% Ur) por 25/30 ciclos (monofásico a 0°)	30% (70% Ur) por 25/30 ciclos (monofásico a 0°)	
	Interrupções de Tensão 100% (0% Ur) por 250/300 ciclos	Interrupções de Tensão 100% (0% Ur) por 250/300 ciclos	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ


PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

Identificação dos Comandos e Controles das Mesas Cirúrgicas:

Controle de Mão para Mesa Cirúrgica MC357L - 135Kg:

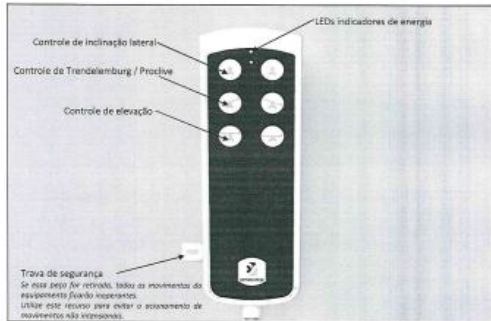


- Este modelo de controle é utilizado nas Mesas Cirúrgicas com capacidade para 135Kg, e controlam os movimentos elétricos desse equipamento.
- Os LEDs indicam qual energia está sendo utilizada na alimentação do equipamento (energia da bateria interna, ou energia diretamente vinda da rede). A função desses LEDs é a mesma para todos os modelos.
- Os botões indicados pelas setas farão o movimento descrito em uma das direções; para o movimento inverso, pressione os botões do lado contrário (não indicados por setas).

19



Identificação dos Comandos e Controles das Mesas Cirúrgicas:

Controle Supervisor (Fixo)
para Mesas Cirúrgicas MC357L - 135Kg:

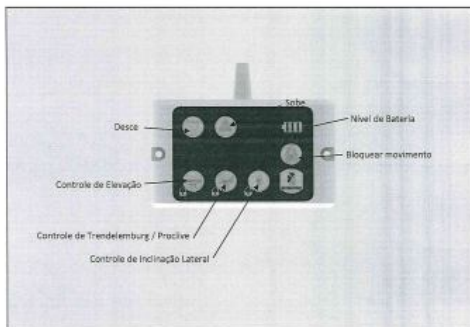

- Este modelo de controle é utilizado nas Mesas Cirúrgicas com capacidade para 135Kg, e controlam os movimentos elétricos desse equipamento.
- Possui LEDs indicativos do nível de bateria do equipamento.
- Para realizar o movimento desejado, segure a tecla correspondente ao movimento e, em seguida, segure o botão "Sobre" ou "Desce" para realizar o movimento. Os dois botões (desce/sobe e o movimento escolhido) devem ser pressionados juntos para que o movimento seja executado.
- O botão de "bloqueio", bloqueia o movimento sendo segurado no momento em que ele for pressionado, para garantir que não haja movimentação acidental ou não intencional da mesa; para desbloquear o movimento, faça o mesmo processo de ativação no movimento que foi bloqueado.

20



Identificação dos Comandos e Controles das Mesas Cirúrgicas:

Controle de Mão para Mesa Cirúrgica MC357BL - 250Kg
e MC357B - 350Kg:




- Este modelo de controle é utilizado nas Mesas Cirúrgicas com capacidade para 250 e 350Kg, e controlam os movimentos elétricos desse equipamento.
- Os LEDs indicam qual energia está sendo utilizada na alimentação do equipamento (energia da bateria interna, ou energia diretamente vinda da rede). A função desses LEDs é a mesma para todos os modelos.
- Os botões indicados pelas setas farão o movimento descrito em uma das direções; para o movimento inverso, pressione os botões do lado contrário (não indicados por setas).



Identificação dos Comandos e Controles das Mesas Cirúrgicas:

Controle Supervisor (Fixo)
para Mesas Cirúrgicas MC357BL - 250Kg e MC357B - 350Kg:

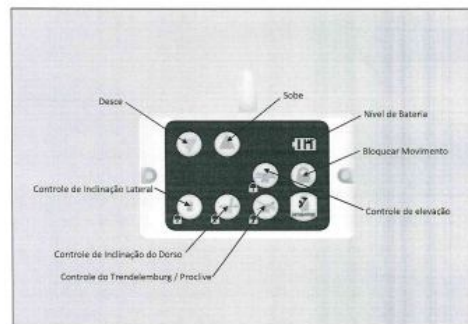

- Este modelo de controle é utilizado nas Mesas Cirúrgicas com capacidade para 250 e 350Kg, e controlam os movimentos elétricos desse equipamento.
- Possui LEDs indicativos do nível de bateria do equipamento.
- A operação deste controle é idêntica à do controle utilizado nas mesas de 135Kg, descrita na página 19 deste manual.

22



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO


Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.



Identificação dos Comandos e Controles das Mesas Cirúrgicas MC357BL - 250Kg:

Controle de Elevação do Renal e Freios:

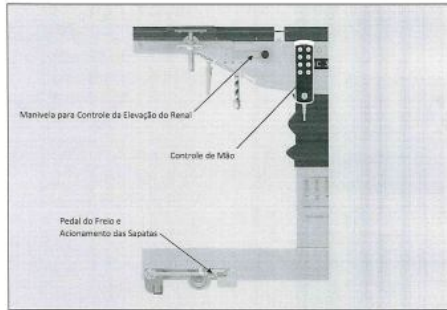


- Para movimentar para cima, gire a manivela no sentido horário, e faça o movimento inverso para descer.
 - Ao acionar o pedal do freio, as sapatas serão empurradas para baixo, fazendo com que a mesa seja elevada o suficiente para que os rodízios não toquem o chão, dando mais firmeza à mesa quando for necessária a fixação da mesma. Para acionar o pedal, pressione com o pé, aplicando força para baixo; em seguida, enquanto aplica força no pedal, arraste o mesmo para o lado oposto ao da base da mesa. Desta forma, as sapatas serão levantadas e a mesa poderá ser movimentada.
- Atenção:** O equipamento não deve ser operado durante cirurgia sem que os freios dos rodízios e as sapatas sejam acionadas.
- Os rodízios do lado da perna possuem freios que podem ser acionados para aumentar ainda mais a firmeza do equipamento enquanto estiver sendo utilizado. Os freios são suaves e não requerem força excessiva para seu acionamento.
 - O controle de mão possui um apoio em sua parte traseira, possibilitando o seu suporte nas regiões das laterais para fixação de acessórios.

23



Identificação dos Comandos e Controles das Mesas Cirúrgicas:

Ligar, desligar, entrada de energia e botão de emergência:

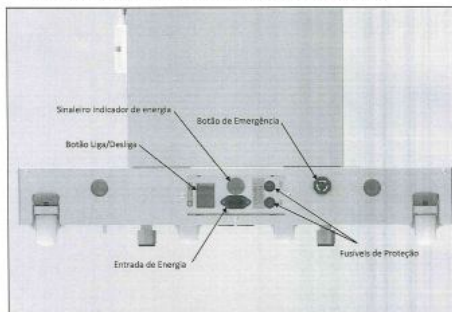


- O botão liga/desliga, permite o impede a entrada de energia no equipamento, e deve ser ativado para que o equipamento inicie sua operação.
- O botão de emergência interromperá completamente o funcionamento do equipamento em caso de necessidade de parada de emergência. Basta apertá-lo e o equipamento será desconectado de todas as fontes de energia elétrica, inclusive sua bateria interna. Para voltar ao funcionamento normal, gire o botão no sentido indicado pelas setas no mesmo (sentido horário).
- Todos os modelos de mesa cirúrgica fabricados pela Ortosintese funcionam em uma faixa de 110-220V, e sua alimentação é protegida por dois fusíveis de 3A cada. Para informações a respeito de substituição de fusíveis, ver "Capítulo 7 - Manutenção".
- O sinalizador indicará quando o equipamento estiver ligado e quando estiver desligado.


24



Adesivo explicativo para as informações apresentadas por via de LEDs:

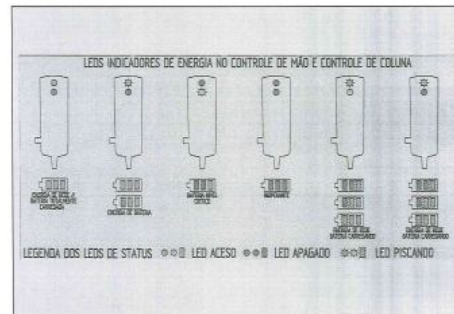

Obs.: Esse adesivo está fixado na parte externa de todos os equipamentos para consulta de forma mais prática e imediata.

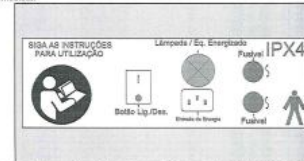

O adesivo acima está presente em todas as mesas cirúrgicas, posicionado logo acima da entrada de energia do equipamento.

25



Capítulo 5 - Módulo de Bateria

O módulo de bateria é utilizado para suprir uma possível interrupção na alimentação da rede elétrica onde a mesa cirúrgica está conectada.

A central de comando é alimentada por 2 baterias de 1,3Ah seladas e recarregáveis. Fornecem tensão de 24VCC para alimentar os atuadores.

A central de comando é responsável pela carga do módulo de bateria.

Pelo fato de a bateria ter um sentido de polarização, ela é protegida por um sistema anti polarização reversa para evitar danos no caso de conexão incorreta.

Caso a bateria fique por um período maior que 3 meses sem ser carregada e utilizada, a mesma deve ser trocada para garantir a sua eficiência máxima e funcionamento correto.


Atenção: A substituição da bateria deve ser feita somente por pessoal autorizado, sendo estes: pessoal da Ortosintese ou um de seus representantes autorizados. Certifique-se também de que a bateria seja descartada em local adequado e de maneira correta para não causar danos ao meio ambiente.

A fabricação das mesas com baterias com maior autonomia pode ser possível, porém, tal ato está sujeito a consulta da Ortosintese, que avaliará a possibilidade de realizar essa modificação.

Atenção: No caso de qualquer tipo de dúvida a respeito do funcionamento do aterramento de proteção, use somente a alimentação elétrica proveniente da bateria interna do equipamento. Antes de sua utilização, atente-se ao nível da bateria, certificando-se de que esteja completamente carregada, e então desconecte o plugue de alimentação da tomada. É importante ressaltar que a bateria tem uma autonomia limitada, e deve ser recarregada após o uso.

Para mais informações a respeito da manutenção do módulo de bateria e a sua autonomia, veja o "Capítulo 7 - Manutenção".

Abaixo, segue um esquemático das ligações elétricas do equipamento:

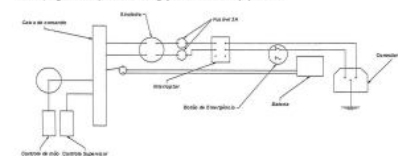

26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

Capítulo 6 - Acessórios

As Mesas Cirúrgicas da Ortosintese possuem diversos acessórios que são utilizados em vários tipos de cirurgia, de forma segura e eficiente.

Os acessórios, apesar de deverem ser utilizados por profissionais treinados e com experiência na área, são de fácil conexão e utilização, podendo ser preparados para utilização em poucos minutos.


Os operadores devem se atentar ao modelo do equipamento antes de utilizarem os acessórios, pois cada um possui seus acessórios respectivos específicos. Os acessórios utilizados devem ser exclusivamente os fabricados pela Ortosintese, para que sua qualidade e segurança sejam garantidas e o equipamento trabalhe com seu desempenho máximo e não ofereça riscos aos operadores ou pacientes.

Neste capítulo, serão apresentados todos os acessórios disponíveis para as Mesas Cirúrgicas.

Atenção: Todas as imagens apresentadas neste manual, tanto dos acessórios quanto do próprio equipamento, são meramente ilustrativas, e deve-se atentar para que os acessórios utilizados sejam correspondentes ao equipamento ao qual serão conectados. Para esclarecimento de qualquer dúvida relacionada aos acessórios, entre em contato com a assistência técnica da Ortosintese, ou com uma das várias assistências autorizadas pela mesma, das quais os contatos estão disponíveis no final deste manual.




Acessórios

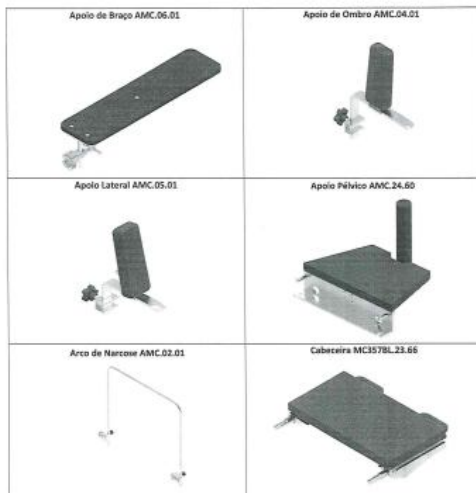

28



Acessórios

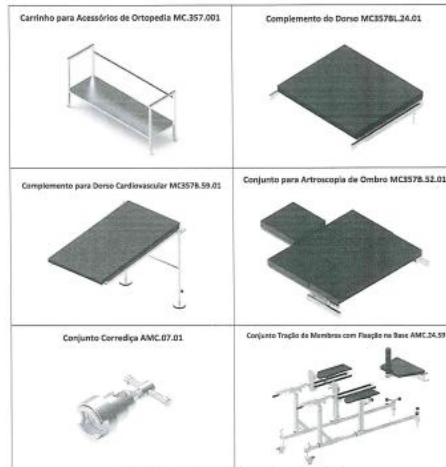

29



Acessórios



30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.



Acessórios



As peças podem ser substituídas. Podem mudar de acordo com o modelo.

Informativo

Identificação do produto

Placa de identificação



Placa de identificação (exemplo)



Fig. 167
Posição da placa de identificação na mesa cirúrgica
1) Placa de identificação

Identificação para o mercado brasileiro



Fig. 168

Símbolos utilizados

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Faixa de umidade de ar permitida para transporte e armazenamento		Faixa de pressão atmosférica permitida para transporte e armazenamento
	Ponto principal		Faixa de temperatura permitida para transporte e armazenamento
	Nome e endereço do fabricante		Data de fabricação
	Em cima		Material embalado frágil
	Proteger contra umidade		Siga o Manual de Instruções!
	Equalização de potencial no painel de alimentação		Este produto inclui partes aplicadas do tipo B conforme a IEC 60601-1:2005 + Correção:2006 + Correção:2007 + Adição:2012, ver "Glossário", na primeira parte deste manual de instruções
	Ponto de contato do condutor de proteção (símbolo na mesa cirúrgica)		Não se sentar aqui!
	Peso da mesa cirúrgica		Classe de proteção I (símbolo na placa de identificação)
	Para soltar a placa de cabeça, pressionar o botão de desbloqueio!		Aviso de tensão elétrica perigosa!
	Perigo de esmagamento!		Equipamento médico elétrico da Classe AP conforme IEC 60601-1:2005 + Correção:2006 + Correção:2007 + Adição:2012
	340 kg Carga de trabalho segura (aquí: 360 kg) e o próprio peso da mesa cirúrgica (aquí: 290 kg)		A Bateria encontra-se no verso do adesivo
	Pressionar a alavanca para cima para ajustar a placa de pernas!		A embalagem é reciclada na Alemanha no sistema RESY?
	Posicionamento incorreto do estofado		Posicionamento correto do estofado
	Pressionar o botão para ajustar a placa de pernas!		Para soltar a placa de pernas, pressione o botão de desbloqueio!

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA N° Id. 2041243L

133

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Em caso de utilização de equipamentos de cirurgia de alta frequência e de aparelhos de desfibrilação, isolar os pacientes da mesa cirúrgica e dos respectivos acessórios!		Para elevar toda a área da placa de cabeça, deslocar dois botões para fora na parte inferior
	Para inclinar a placa de cabeça, pressionar o botão na parte inferior		Somente para uso Interno
	Em uma subida de pelo menos 5°, a mesa cirúrgica pode tombar e ferir pessoas! Para transporte ajustar a posição de transporte, ver capítulo "Mobilidade" na primeira parte desse Manual de instruções.		Se o adaptador universal for colocado no assento, o adaptador universal e os acessórios fixos no mesmo podem colidir com a coluna de elevação durante o deslocamento longitudinal. Por isso, execute o deslocamento longitudinal do leito apenas de forma que o adaptador universal no assento não colida com a coluna de elevação.
	Atenção! (Símbolo de aviso geral)		Ao pressionar o botão de desbloqueio, este acessório não está fixado na mesa cirúrgica e pode ser removido.
	O equipamento está sujeito à Diretiva CE 2012/19/UE.		Ao pressionar o botão de desbloqueio, este acessório não está fixado na mesa cirúrgica e pode ser removido.
	Quando o botão de desbloqueio não está pressionado, este acessório está fixado na mesa cirúrgica e não pode ser removido.		Quando o botão de desbloqueio não está pressionado, este acessório está fixado na mesa cirúrgica e não pode ser removido.
	Quando o botão de desbloqueio não está pressionado, este acessório está fixado na mesa cirúrgica e não pode ser removido.		

134

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA N° Id. 2041243L

132

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA N° Id. 2041243L



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Opções de ajuste da placa buco-maxilofacial ao manejar o parafuso de travamento na parte inferior da peça para decúbito dorsal		Opções de ajuste de placa buco-maxilofacial ao manejar a alavanca manual
	Opções de ajuste da placa buco-maxilofacial ao manejar o parafuso de travamento esquerdo		Opções de ajuste de placa buco-maxilofacial ao manejar o parafuso de travamento direito
	Opções de ajuste da placa buco-maxilofacial ao manejar o parafuso de travamento inferior		Não transportar pacientes sobre a mesa cirúrgica com o dispositivo de extensão montado ou na posição genucubital!
	O produto satisfaz os requisitos da Diretiva UE 93/42/CEE, Anexo 1.		Esse acessório pode ser carregado com uma carga de trabalho segura de 118 kg! Corresponde a um paciente com um peso corporal de 225 kg (valores exemplificativos).
	Reposição correta da unidade elétrica de comando de emergência (ver capítulo "Unidade de comando de emergência" na primeira parte deste manual de instruções)		Encaixar este cabo apenas na tomada de conexão marcada em azul!
	Encaixar este cabo apenas na tomada de conexão marcada em azul!		Em caso de abaixamento do leito, observar a placa de pernas!

Tab. 15 Símbolos utilizados e o seu significado

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L

135

Dados técnicos

Reserve-se o direito de modificar dimensões e detalhes de fabricação. Dados Técnicos dos acessórios: ver capítulo "Finalidade" na primeira parte deste manual de instruções.

Pequenos desvios dos valores indicados neste manual de instruções são decorrentes do tipo de construção e não constituem qualquer defeito.

Dimensões	Valores	Ilustração
Dimensões externas do chassi (comprimento x largura)	1.140 x 705 mm	
Leito, sem acessórios (comprimento x largura)	960 mm x 550 mm	
Largura total do assento e do encosto (incluindo trilhos laterais)	600 mm	
Comprimento da placa de pernas (101.0116.0)	700 mm	
Comprimento do prolongamento do encosto	280 mm	
Comprimento da placa de cabeça	300 mm	
Diâmetro das rodas duplas	125 mm	

Tab. 16 Dimensões

136

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L

Zona de ajuste	Máxima	Ilustração
Área de ajuste da altura (sem estofado)	680 - 1180 mm	
Ajuste para a posição Trendelenburg/Trendelenburg reverso	-30° - 30°	
Ajuste lateral	-20° - +20°	
Inclinação do encosto	-40° - +70°	
Inclinação da placa de cabeça, com mola a gás	+48° - +28°	
Ângulo de colocação do estofado da cabeceira	0° - 25°	
Inclinação do prolongamento basculável do encosto	0° - 40°	
Bifurcação das placas de pernas	0° - 60°	

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L

137

Zona de ajuste	Máxima	Ilustração
Inclinação com mola a gás das placas de pernas de duas peças (101.0116.1)	+90° - 10°	
Ângulo de ajuste da placa de pernas de quatro peças (101.0171.0)	+155° - 0°	
Inclinação eletro-hidráulica de placas de pernas	-90° - +70°	
Deslocamento longitudinal eletro-hidráulico do leito	-150 mm - +150 mm	

Tab. 17 Zonas de ajuste

138

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

Parâmetros	Valor
Carga de trabalho segura (peso máximo permitido do paciente menos o peso dos acessórios fixos na mesa cirúrgica, ver "Glossário" na primeira parte deste manual de instruções)	360 kg
Capacidade de carga estática, condições: <ul style="list-style-type: none">• a superfície do apoio está na posição horizontal,• a superfície do apoio está na posição mais baixa,• a superfície do apoio está no centro acima da coluna de elevação,• não é feito nenhum deslocamento longitudinal,• não é feito nenhum ajuste,• a mesa cirúrgica não é deslocada.	até 454 kg
Vida útil esperada, ver "Glossário" na primeira parte deste manual de instruções	10 anos, em caso de cumprimento das inspeções recomendadas.
Peso total incluindo placas de pernas e de cabeça e prolongamento do encosto	290 kg
Operação com bateria	✓
Carregador integrado/Fonte de alimentação	✓
Funcionamento de emergência	Em caso de falha das baterias, é possível um funcionamento de emergência através da conexão do plugue de rede e da comutação para a operação em rede. Você encontra mais informações no capítulo "Ligar/desligar mesa cirúrgica" na primeira parte deste manual de instruções. Em caso de falha de todo o sistema eletrônico, é possível um funcionamento de emergência manual com a ajuda dos botões rotativos de pré-seleção de função e da bomba a pedal. Você encontra mais informações no capítulo "Funcionamento de emergência manual" na primeira parte deste manual de instruções.
Faixa de tensão, frequência e consumo de corrente da fonte de alimentação	ver placa de identificação no equipamento
Grau de proteção, ver "Glossário" na primeira parte deste manual de instruções	IP X4
Classe de proteção, ver "Glossário" na primeira parte deste manual de instruções	I
Tipo de serviço nominal, ver "Glossário" na primeira parte deste manual de instruções	Serviço intermitente periódico (tipo de serviço S3) INT 1,5 min/8,5 min (O equipamento não foi concebido para o serviço contínuo. Após 1,5 min. de funcionamento com carga total, são necessários 8,5 min. de pausa.)
Classe de proteção (mistura inflamável de agentes anestésicos, ver "Glossário" na primeira parte deste manual de instruções)	Classe AP ("anaesthetic proof")

Tab. 18

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA N° Id. 2041243L

139

Outros dados técnicos

informativo

140

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA N° Id. 2041243L

Condição ambiental permitida	No armazenamento e transporte	Em operação
Temperatura ambiente	-20°C – +50°C	10°C – +40°C
Umidade relativa do ar	10% – 95%	10% – 95%
Pressão atmosférica	500 – 1.060 hPa	–
Altura de operação máxima permitida	–	4.000 m acima do nível do mar

Tab. 19

Condições ambientais permitidas

Dados técnicos dos estofados

Tipo de estofado	condutor
Superfície	Isa
Cor	preto
Vida útil	4-6 anos

Tab. 20

Dados técnicos dos estofados

Dados técnicos das fitas adesivas de gel

Resistência à tração	no mín. 50 kPa
Resistência contra ruptura por alongamento	no mín. 300%
Deformação sobre pressão (50% de deformação/22 h/70°C)	<10%
Resistência e temperaturas	-30°C ... +80°C
Vida útil	no mín. 5 anos

Tab. 21

Dados técnicos das fitas adesivas de gel

Parâmetros	Valor
Altura	490 – 690 mm
Comprimento	500 mm
Largura	510 mm
Peso (sem adaptador)	16 kg
Carga máxima de trabalho	135 kg

Tab. 22

Dados técnicos do dispositivo de posicionamento gencubital (001.0150.0)

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA N° Id. 2041243L

141

Acessórios permitidos

Os acessórios da SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co.KG foram desenvolvidos e adaptados especialmente para este produto (ver "Tab. 23" na página 147). Os acessórios de terceiros devem ser verificados e usados com base nos respectivos manuais de instruções (ver "Tab. 24" na página 150).
(*) Entre parênteses está indicado o respectivo peso do paciente.
Exemplo: uma carga de trabalho segura de "50 (250) kg" indica que o acessório pode ser carregado com um peso de até 50 kg. A respectiva parte do corpo passando 50 kg é um indicativo de um peso total de 250 kg (ver imagem ao lado).
O peso corporal total indicado resulta da distribuição padrão recolhida estatisticamente. Os valores entre parênteses podem, por isso, ser apenas valores aproximados para o peso máximo efetivo dos pacientes.




Fig. 169
Explicação da seguinte tabela

informativo

142

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA N° Id. 2041243L



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

Accessórios permitidos da SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

Nº art.	Descrição	Carga de trabalho segura conforme IEC 60601-1:2005 (*)	Peso próprio por unidade
101.0121.0	Suporta	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0162.0	Apoio para as costas e nádegas	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0176.0	Apoio para pulsos/escro/esterno	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0115.0	Apoio para pernas Göpel	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0211.0	Almofada de estofado	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0139.0	Suporte de infusão	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0012.0	Arco de anestesia	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0018.0	Fixador, giratório com fecho rápido	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0219.0	Apoio para pernas Göpel	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0192.0	Apoio de braços	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0109.1	Apoio de braços	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
203.1070.0	Apoio de braços	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0117.0	Fixador	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.1670.0	Fixador	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0145.2	Placa de pernas, de uma peça	88 (360) kg	17,4 kg
101.0116.2	Placa de pernas, de duas peças, sem recorte ginecológico	44 (360) kg	9 kg
101.0072.2	Placa de cabeça com duplo ajuste	14,5 (360) kg	11,6 kg
101.0131.1	Prolongamento do encosto, fixo	68 (360) kg	12,0 kg
101.0159.0	Prolongamento do encosto, basculável	72 (360) kg	13,5 kg
101.0123.0	Imobilizador de mão	26 (360) kg	0,54 kg
101.0204.1	Adaptador ginecológico	80 (135) kg	10,6 kg
101.0365.0	Peça intermediária	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0368.0	Placa de pé	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0210.0	Placa de ombros (apenas juntamente com a peça intermediária 101.0365.0 ou a peça de fixação 101.0187.0 e o encosto de cabeça 101.0155.0)	137 (225) kg	11,2 kg
101.0244.1	Placa para cirurgia do ombro	118 (225) kg	12,1 kg
101.0141.1	Adaptador universal	---	2,5 kg
101.0206.1	Unidade de comando de pé, com fio	---	3,5 kg
101.0380.1	Comando manual, cabo	---	2,5 kg
101.0245.0	Apoio lateral para placa para cirurgia do ombro	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0266.0	Apoio de cabeça para cirurgias nos ombros	Ver manual de instruções específico de acessórios	---

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L 143

Nº art.	Descrição	Carga de trabalho segura conforme IEC 60601-1:2005 (*)	Peso próprio por unidade
101.0364.0	Peça intermediária	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0171.1	Placa de pernas, de quatro peças	---	10,06
101.0147.0	Fixador	Ver manual de instruções específico de acessórios	---
101.0590.1	Comando manual, cabo	---	2,5 kg
101.0177.1	Suporte de corpo	---	---
101.0101.0	Suporte de ombro (par)	---	---
101.0247.0	Proteção contra respingos	---	---
101.0430.0	Duplicação (apenas juntamente com um assento com recorte ginecológico e encosto curto em caso de possibilidade de alojamento para a duplicação)	250 (360) kg	6,5 kg
101.0460.0	Duplicação (apenas juntamente com um assento com recorte ginecológico e encosto longo em caso de possibilidade de alojamento para a duplicação)	290 (360) kg	7 kg
101.0480.0	Duplicação (apenas juntamente com a placa de cabeça 101.0017.1, em caso de possibilidade de alojamento para a duplicação)	14,5 (360) kg	2,5 kg
101.0490.0	Duplicação (apenas juntamente com a placa de pernas, de uma peça 101.0145.1 em caso de possibilidade de alojamento para a duplicação)	88 (360) kg	3,5 kg
101.0500.0	Duplicação (apenas juntamente com a placa de pernas, dividida 101.0116.1 em caso de possibilidade de alojamento para a duplicação)	44 (360) kg	2,5 kg
101.0510.0	Duplicação (apenas juntamente com o prolongamento do encosto, fixo 101.0131.1 em caso de possibilidade de alojamento para a duplicação)	68 (360) kg	3 kg
101.0540.0	Duplicação (apenas juntamente com a placa de pernas, de quatro peças 101.0171.1 em caso de possibilidade de alojamento para a duplicação)	44 (360) kg	2,5 kg
101.0580.0	Duplicação (apenas juntamente com o prolongamento do encosto, basculável 101.0159.0 em caso de possibilidade de alojamento para a duplicação)	72 (360) kg	3,2 kg
101.0137.0	Imobilizador de mão	23 (360) kg	0,2 kg
101.0135.0	Rolo de apoio (apenas juntamente com o suporte 101.0121.0)	72 (320) kg	1 kg
101.0151.0	Suporte de ombro/suporte lateral (apenas juntamente com o suporte 101.0121.0)	72 (320) kg	1 kg
101.0164.0	Imobilizador para perna	23 (300) kg	0,5 kg
101.0178.0	Rolo de apoio (apenas juntamente com o fixador 101.0132.0 ou 101.0146.0)	56 (300) kg	4,5 kg
101.0186.0	Almofada de apoio (apenas juntamente com 2 fixadores 101.0132.0)	56 (250) kg	7 kg
101.0122.0	Placa para posicionamento de úmero (apenas juntamente com o fixador 101.0117.0)	15,8 (250) kg	3 kg
101.7200.1	Apoio de braço especial (leito em fibra de carbono)	25 (225) kg	6,0 kg

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L 144

Nº art.	Descrição	Carga de trabalho segura conforme IEC 60601-1:2005 (*)	Peso próprio por unidade:
101.0570.0	Placa de pernas de quatro peças ModulLeg	por placa de pernas: 41,5 (225) kg	por placa de pernas: 12 kg
101.0362.1	Bacia (apenas juntamente com o adaptador ginecológico 101.0204.0)	---	---
101.0014.0	Estrêbo fixador (apenas juntamente com 2 fixadores 101.0016.0)	52 (225) kg	3,5 kg
101.7151.1	Placa de carbono Com apoio Sem apoio	165 (225) kg 102 (140) kg	8,5 kg
101.0107.0	Suporte lateral	23 (135) kg	1 kg
101.0150.0	Dispositivo de posicionamento genucubital	80 (135) kg	17 kg
101.0190.0	Almofada lateral (apenas juntamente com dispositivo de posicionamento genucubital 101.0013.0)	23 (135) kg	1 kg
101.0126.0	Peça de conexão (apenas juntamente com o fixador, não giratório 101.0132.0, o braço de suporte 101.0122.0 e os encostos de cabeça 101.0155.0 ou 101.0179.0)	12 (135) kg	3 kg
101.0197.1	Adaptador urológico	90 (135) kg	13,0 kg
101.0520.1	Duplicação (apenas juntamente com o adaptador urológico 101.0197.0 em caso de possibilidade de alojamento para a duplicação)	90 (135) kg	2,0 kg
101.0530.0	Duplicação (apenas juntamente com o adaptador ginecológico 101.0204.0 em caso de possibilidade de alojamento para a duplicação)	80 (135) kg	2,0 kg
101.0239.0	Placa para cirurgia pediátrica	130 kg	13,5 kg
101.0109.0	Apoios de cotovelos (apenas juntamente com o adaptador urológico 101.0197.0) para o apoio do médico durante a intervenção)	35 kg	5,5 kg
101.0196.0	Suporte de punho (apenas juntamente com o adaptador para placa de cabeça 101.0167.0 e a peça de fixação 101.0187.0)	10 kg	1 kg
101.0170.0	Bacia com suporte	---	2 kg
101.0182.0	Bacia basculante com suporte	---	6 kg
101.0191.0	Aplicação para filtragem (apenas juntamente com 101.0182.0 ou 101.0584.0)	---	1 kg
101.0585.0	Recipiente para instrumentos usados (apenas juntamente com o adaptador ginecológico 101.0204.0 ou o adaptador urológico 101.0197.0)	---	16 kg
101.0584.1	Lavagem ginecológica	---	14 kg
101.0441.1	Placa bucinomaxilar	225 kg	---
101.7152.0	Trilho lateral (apenas juntamente com a placa de carbono 101.7151.0)	---	2,0 kg
101.0163.1	Dispositivo de tração de mão Weinberger (apenas juntamente com o dispositivo de posicionamento do úmero 101.0134.0)	---	1 kg
101.0136.0	Dispositivo de posicionamento do úmero (apenas juntamente com o fixador 101.0146.0)	---	5 kg
101.0152.0	Barra de contra-tração para o úmero (apenas juntamente com o fixador 101.0146.0)	---	4 kg
101.0410.0	Bases para posicionamento das placas de cabeça/ de pernas	---	63 kg
101.0420.0	Módulo de integração SCHMITZ	---	---

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L 145

Nº art.	Descrição	Carga de trabalho segura conforme IEC 60601-1:2005 (*)	Peso próprio por unidade:
101.0220.0	Cabo de equalização de potencial	---	0,1 kg
101.0230.0	Cabo de equalização de potencial	---	0,5 kg
101.0228.0	Comedea para cassetes	---	3 kg
101.0586.0	Apoio de mão	---	3 kg
101.0589.0	Bandeja de instrumentos ginecológicos	15 kg	---
101.0132.0	Fixador, não giratório	---	1 kg
101.0146.0	Fixador, giratório	---	1 kg
101.0111.0	Estendão do arco de anestesia (apenas juntamente com arco de anestesia 101.0012.0)	---	2,0 kg
101.0270.0	Dispositivo de extensão e seus acessórios	---	---
101.0120.0	Carro de acessórios cirúrgicos	---	17 kg
101.0185.0	Cinta de imobilização para pernas	---	---
101.0108.0	Placa para cirurgia nas mãos	20 (300) kg	7,5 kg
101.0218.0	Placa para transferência de pernas, dividida	24 (185) kg	6,0 kg
101.0370.0	Apoio para pernas com mola a gás, carga pesada	---	---
101.0216.1	Unidade de comando de pé, Bluetooth®	---	3,5 kg
101.0214.0	Comando manual, Bluetooth®	---	2,5 kg
101.0369.0	Apoio para pernas com mola a gás	---	---
101.0359.0	Unidade de comando de pé, com fio	---	---
101.0591.1	Comando manual, Bluetooth®	---	---
101.0356.0	Carregador, vertical	---	---
101.0357.0	Carregador para a montagem na parede	---	---
101.0358.0	Carregador para colocação em um trilho lateral	---	---
101.0019.0	Apoio de braços	---	---
101.0252.0	Cinta de fixação, 840 mm de comprimento	---	---
101.0252.0	Cinta de fixação, 1460 mm de comprimento	---	---
101.0455.0	Cinta para o corpo	---	---
101.0421.0	Módulo de integração SCHMITZ	---	---
101.0248.0	Grade lateral (par)	---	---
101.0249.0	Estofado para as grades laterais	---	---
101.0504.0	Carinho de limpeza para mesa cirúrgica DIAMOND	---	---
101.0443.0	Estendão da mesa	---	---
101.0105.0	Dispositivo de tração	---	---
101.0110.0	Dispositivo de encaixe	---	---
101.0221.0	Carro de transporte	---	---
101.0240.0	Adaptador de comprimento para aparelho de estendão	---	---
101.0250.0	Mandril de sustentação	---	---
101.0260.0	Mandril de sustentação	---	---
101.0290.0	Carro de transporte	---	---
101.0324.0	Placa do assento para a posição lateral	---	---
101.0491.0	Placa do assento para a posição supina	---	---
101.0165.0	Arco de fio de Kirschner	---	---

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L 146



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

Nº art.	Descrição	Carga de trabalho segura conforme IEC 60601-1:2005 (*)	Peso próprio por unidade:
101.0193.0	Prolongamento de trilhos laterais	---	---
101.0201.0	Placas de pé (par)	---	---
101.0205.0	Botas de tração (par)	---	---
101.0254.0	Fixação condilar	---	---
101.0280.0	Dispositivo de posicionamento de panturrilhas	---	---
101.0340.0	Bloco para engessamento com apoio do púbis	---	---
101.0350.0	Barra de contra-tração para decúbito lateral	---	---
101.0320.0	Estofado para artroscopia do quadril	---	---
101.0501.0	Almofada para o pescoço	---	---
101.0502.0	Adaptador tribo lateral	---	---
101.0503.0	Estofado intermediário	---	---
101.0571.0	Porta-coxas para a placa de pernas de quatro peças 101.0570.0	---	---
101.0449.0	Placa para bandeja de instrumentos ginecológicos	---	---
101.0430.0	Duplicação para assento com recorte ginecológico ou para encosto curto	---	---

Tab. 23
Acessórios permitidos da SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

Nº art.	Acessórios permitidos como mercadoria	Fabricante
101.0187.0	Peça de fixação, com alojamento quadrado central (apenas juntamente com os apoios de cabeça em ferradura 101.0155.0 ou 101.0179.0, o adaptador universal 101.0141.0 ou a placa para cirurgia do ombro 101.0244.0)	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0155.0	Apoio de cabeça em ferradura, de uma peça (apenas juntamente com o adaptador para placa de cabeça 101.0167.0 ou a peça de fixação 101.0187.0 e o adaptador universal 101.0141.0)	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0179.0	Apoio de cabeça em ferradura, de duas peças (apenas juntamente com o adaptador para placa de cabeça 101.0167.0 ou a peça de fixação 101.0187.0 e o adaptador universal 101.0141.0)	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0013.0	Apoio de cabeça para cirurgias nos ombros (apenas juntamente com o adaptador para placa de cabeça 101.0167.0)	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0202.0	Placa de pé	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0015.0	Almofada de estofado	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0212.0	Dispositivo de posicionamento do joelho (apenas juntamente com o fixador, giratório 101.0145.0)	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0153.0	Proteção do braço	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0166.0	Mesa porta-instrumentos	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0203.0	Colchão em túnel	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0208.0	Almofada em cunha dupla	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0583.0	Apoio para artroscopia do joelho	Reison Medical AB
101.0253.0	Sistema de tração do ombro	Amatech
101.0255.0	Apoio para braço em material estéril	Amatech
101.0256.0	Suporte para cassetes RX	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0070.1	Placa para cirurgia nas mãos	Reison Medical AB
101.0200.0	Elementos alargadores de 300 mm	Reison Medical AB
101.0257.0	Suporte axilar	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0258.0	Suporte de articulação do cotovelo	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0259.0	Suporte de perna	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0261.0	Barra de manípulo	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0224.0	Haste telescópica	novilla medical gmbh & co kg
101.0310.0	Sapato especial	Condor GmbH
101.0330.0	Sapato interno único	Condor GmbH
101.0256.0	Apoio de cabeça em ferradura ajustável com uma mão	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0486.0	Fixador craniano neurocirúrgico radiotransparante DORO LUCENT	Pro Med Instruments GmbH
101.0366.0	Sistema Fluid Collection	Amatech
101.0499.0	Saco de recolha	Amatech
101.0327.0	Acolchoado em gel para decúbito lateral	Trulife Ltd
101.0328.0	Almofada em gel para calcânhar (par)	Trulife Ltd
101.0329.0	Anel em gel para cabeça	Trulife Ltd
101.0331.0	Anel em gel para cabeça	Trulife Ltd

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L 149

Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L 147

Nº art.	Designação	Fabricante
101.0154.0	Porta-tubos (apenas juntamente com o fixador, giratório 101.0146.0)	Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH
101.0125.0	Arco de anestesia flexível (apenas juntamente com 2 fixadores, giratórios 101.0146.0)	Reison Medical AB
101.0142.0	Suporte universal tipo DORO	Pro Med Instruments GmbH
101.0113.0	Adaptador para fixador craniano Doro	Pro Med Instruments GmbH
101.0168.0	Adaptador para fixador craniano Doro com articulação esférica	Pro Med Instruments GmbH
101.0127.0	Skull Clamp DORO	Pro Med Instruments GmbH
101.0156.0	Apoio circular de cabeça tipo DORO	Pro Med Instruments GmbH
101.0181.0	Pinos de sustentação DORO para a cabeça	Pro Med Instruments GmbH
101.0188.0	Pinos de sustentação DORO para a cabeça	Pro Med Instruments GmbH
101.0217.0	Apoio para as pernas Cysto Lift (par)	Amatech
101.0571.0	Porta-coxas (apenas juntamente com a placa de pernas de quatro peças 101.0570.0)	DPMS
101.0581.0	Colchão de vácuo, curto	Schmitzler Rettungsprodukte GmbH & Co.KG
101.0682.0	Colchão de vácuo, longo	Schmitzler Rettungsprodukte GmbH & Co.KG
101.0560.0	RotaxTable	Condor GmbH
101.0189.0	Acolchoado em gel para decúbito lateral	Trulife Ltd
101.0195.0	Almofada em gel para calcânhar	Trulife Ltd
101.0143.0	Anel em gel para cabeça	Trulife Ltd
101.0157.0	Anel em gel para cabeça	Trulife Ltd
101.0169.0	Anel em gel para cabeça	Trulife Ltd
101.0181.0	Anel em gel para cabeça	Trulife Ltd
101.0194.0	Almofada para cabeça em gel para decúbito ventral	Trulife Ltd
101.0128.0	Almofada para cabeça em gel para decúbito ventral	Trulife Ltd
101.0336.0	Anel em gel para cabeça	Trulife Ltd
101.0337.0	Apoio de cabeça em gel para decúbito dorsal	Trulife Ltd
101.0338.0	Apoio de cabeça em gel para decúbito dorsal	Trulife Ltd
101.0339.0	Almofada meio cilindro em gel	Trulife Ltd
101.0341.0	Almofada em gel para apoio de braço, longa	Trulife Ltd
101.0342.0	Almofada em gel para o suporte para braço, curta	Trulife Ltd
101.0343.0	Almofada em gel para proteção do braço	Trulife Ltd
101.0344.0	Protector de sacro em gel	Trulife Ltd
101.0345.0	Posicionador universal em gel	Trulife Ltd
101.0346.0	Posicionador universal em gel	Trulife Ltd
101.0347.0	Posicionador universal em gel	Trulife Ltd
101.0348.0	Posicionador universal em gel	Trulife Ltd
101.0349.0	Almofadas para apoio de pernas (par)	Trulife Ltd
101.0351.0	Almofada em gel para os joelhos	Trulife Ltd
101.0352.0	Colchão em túnel em gel	Trulife Ltd
101.0353.0	Almofada da mesa em gel	Trulife Ltd
101.0354.0	Almofada da mesa em gel	Trulife Ltd
101.0355.0	Almofadas de estofado em gel	Trulife Ltd

Informativo

148 Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L

Nº art.	Acessórios permitidos como mercadoria	Fabricante
101.0333.0	Anel em gel para cabeça	Trulife Ltd
101.0334.0	Almofada para cabeça em gel para decúbito ventral	Trulife Ltd
101.0547.0	Colchão de vácuo, posição lateral	B.u.W. Schmitt GmbH
101.0548.0	Colchão de vácuo, pad-Sig	B.u.W. Schmitt GmbH
101.0549.0	Colchão de vácuo, SigmaLap	B.u.W. Schmitt GmbH
101.0194.0	Elementos alargadores do leito (500 mm de comprimento)	Amatech
101.0016.0	Apoio para pernas	Amatech
101.0264.0	Apoio para perna, carga pesada	Amatech
101.0185.0	Cinta de imobilização para pernas	Amatech
101.0160.0	Allen Spine System	Allen Amatech
101.0367.0	Fixador	Amatech
101.0332.0	Anel em gel para cabeça	Trulife Ltd
101.0335.0	Apoio de cabeça em gel	Trulife Ltd
101.0335.0	Apoio em gel para decúbito ventral	Trulife Ltd
101.0366.0	Estabilizador do joelho	Amatech

Tab. 24
Acessórios permitidos de outros fabricantes

Informativo

150 Manual de instruções DIAMOND 60 BLK - Edição 2019-03-06 BRA Nº Id. 2041243L



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÁ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporá – MG 19 de Junho de 2023.

DIAMOND
Dados Técnicos
Equipamento

Comprimento da área de leito	960 mm	Equipamento de série:	Superfície de leito composta de duas partes independentes, composta de:
Comprimento do segmento para cabeça	300 mm	- Encaixe	- Encaixe com cavidade para procedimento ginecológico (opcional também sem cavidade para procedimento ginecológico).
Comprimento do segmento para perna	700 mm	Alças laterais:	- Travessalburg/Avtravessalburg lateral
Comprimento do segmento para pé	550 mm	Encaixe	- Segmentos para perna
Comprimento do segmento para tornozelo	450 mm	DIAMOND 50 BK e	DIAMOND 60 BK e
Comprimento do segmento para calcanhar	450 mm	DIAMOND 40 BK e	DIAMOND 60 BK
Comprimento do segmento para punho	450 mm	DIAMOND 40 BK e	DIAMOND 60 BK
Comprimento do segmento para mão	450 mm	DIAMOND 40 BK e	DIAMOND 60 BK
Comprimento do segmento para dedos	450 mm	DIAMOND 40 BK e	DIAMOND 60 BK
Comprimento do segmento para dedos	450 mm	DIAMOND 40 BK e	DIAMOND 60 BK
Comprimento do segmento para dedos	450 mm	DIAMOND 40 BK e	DIAMOND 60 BK
Comprimento do segmento para dedos	450 mm	DIAMOND 40 BK e	DIAMOND 60 BK

... (rest of the table content follows a similar pattern) ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÁ-MG
RUA JOSÉ INACIO FERREIRA Nº 58, CENTRO - ARAPORÁ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORA.MG.GOV.BR

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 011/2023

"Dispõe sobre a declaração de inexigibilidade de licitação para contratação de prestação de serviços de show artístico no Município de Araporá/MG"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAPORÁ, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO que tradicionalmente se comemora o aniversário da cidade, bem como a tradicional festa popular do "XIX Festa do Peão de Boiadeiro", sendo necessário a contratação de shows artísticos para a realização do mesmo;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 25, III da Lei nº 8.666/93 e alterações;

CONSIDERANDO que a cantora "VALERIA BARRROS", é consagrada pela crítica popular;

Acolhendo parecer da Comissão de Licitação e da Douta Assessoria Jurídica, favoráveis a inexigibilidade de licitação para contratação do show artístico.

RESOLVE

I - DECLARAR INEXIGÍVEL a realização do procedimento licitatório, e, RATIFICAR integralmente o processo de inexigibilidade de licitação que versa sobre a prestação de serviços para execução de show artístico da cantora "VALERIA BARRROS", para execução de show artístico no dia 22 de Julho de 2023, durante as comemorações da "XIX Festa do Peão de Boiadeiro", a realizar-se nos dias 20 a 23 de Julho de 2023, no Centro de Eventos e Equoterapia da cidade de Araporá/MG, a ser efetivada com a empresa VALERIA A. BARRROS PROMOCÕES ARTÍSTICAS ME, regularmente inscrita no CNPJ sob n. 20.276.628/0001-21, com sede na Avenida Alphaville Flamboyant, quadra área lote 04 casa 288 residencial Alphaville Flamboyant em Goiânia/GO, no valor de **RS 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)**.

II - Determinar a lavratura do competente contrato ou instrumento equivalente.

Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Araporá/MG, aos 19 dias do mês de junho de 2023.

Sr. EDUARDO RIBEIRO BORGES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÁ-MG
RUA JOSÉ INACIO FERREIRA Nº 58, CENTRO - ARAPORÁ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORA.MG.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÁ-MG
RUA JOSÉ INACIO FERREIRA Nº 58, CENTRO - ARAPORÁ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORA.MG.GOV.BR

DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR

Pregão Eletrônico n. 018/2023
Processo Licitatório n. 063/2023
RECORRENTE: KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA e INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA
RECORRIDA: PREGOIEIRA E EQUIPE DE APOIO

Tendo em vista o que consta na manifestação da pregoeira, julgando os Recursos Administrativos interpostos, conforme transcrito no RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELAS empresas KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico LTDA e Intensimed Comércio de Instrumentos e Mat. Hospitalares LTDA, no certame público cujo objeto trata aquisição de 01(uma) MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, cujos recursos são oriundos do PAJ n. 000312.2016.03.001/2 firmado entre o Município de Araporá e a Procuradoria do Trabalho - Tribunal Regional do trabalho 3ª região de Minas Gerais, decidindo pela **manutenção de sua DECISÃO.**

- Conheço do RECURSO ADMINISTRATIVO impetrado pelas empresas KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico LTDA e Intensimed Comércio de Instrumentos e Mat. Hospitalares LTDA posto que tempestivo, julgando os mesmos IMPROCEDENTES, **MANTENDO A DECISÃO**, tomada pela Pregoeira e Equipe de Apoio, nos exatos termos do RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELAS empresas KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico LTDA e Intensimed Comércio de Instrumentos e Mat. Hospitalares LTDA.

Dê-se ciência e publique-se.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 19 de junho de 2023.

Eliane Santana Martins
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO N. 067/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 082/2023

INEXIGIBILIDADE n. 010/2023

Objeto: Prestação de serviços de show artístico da Dupla "MARCOS PAULO & MARCELO", no dia 21 de julho de 2023, durante as comemorações da "XIX Festa do Peão de Boiadeiro", a realizar-se entre os dias 20 a 23 de julho de 2023, no Centro de Eventos e Equoterapia da cidade de Araporá/MG.
Empresa: PORTAL DOS EVENTOS - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob n. 14.483.631/0001-13, com sede na Avenida Circular, n. 3000, Centro na cidade de Flórida Paulista/SP.
Valor Estimado: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Prazo contrato: O prazo de vigência terá início na data da assinatura do contrato e término em 21/07/2023, dia da realização show.
Dotação orçamentária: 02.04.01.20032.13392.0039.3.3.90.39.00
Fundamentação Legal: Processo de Inexigibilidade n. 010/2023 e Art. 25, III da Lei nº 8.666/93 e alterações;



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ
PROCESSO SELETIVO Nº 003/2023

DECISÃO

A Prefeitura Municipal de Araporã, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista que a Administração tem o poder de, a qualquer momento e de ofício, rever seus próprios atos por conveniência ou oportunidade, a fim de evitar possível gravame ao interesse público, em consonância com a legislação que fundamenta a abertura do Edital Processo Seletivo nº 003/2023, considerando o princípio da legalidade e a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, bem como o parecer Jurídico exarado, resolve REVOGAR o Processo Seletivo nº 003/2023 exclusivamente em atenção ao cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS, no estado em que se encontra.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

Gabinete da Prefeitura Municipal de Araporã/MG, aos 19 dias do mês de junho de 2023.

Celso Romão Guerinio
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado e Cadastro Reserva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ

REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES

Eu _____, inscrito (a) como candidato(a) ao cargo de Agente Comunitário de Saúde no Processo Seletivo nº 03/2023, ao cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS promovido pelo Município de Araporã, venho através do presente solicitar a restituição dos valores desembolsados com a inscrição tendo em vista o cancelamento do Processo Seletivo com relação ao referido cargo.

Para tanto, o MUNICÍPIO DE ARAPORÃ fica autorizado a depositar a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), conforme os seguintes dados:

Nome do candidato: _____

Endereço: _____

Banco: _____ Corrente nº. do banco: _____

Agência: _____

Telefone para contato: _____

O titular da referida conta é _____ portador do CPF nº _____

Declaro ainda que estou ciente que após o processamento da devolução com o devido depósito, dou plena, geral e irrevogável quitação ao MUNICÍPIO DE ARAPORÃ organizadora do certame para nada ter a reclamar, renunciando a qualquer direito que diga respeito ao certame.

Araporã, _____ de _____ de 2023.

(assinatura do candidato)

(Incluir o requerimento com cópia de um documento oficial e do comprovante de pagamento da inscrição)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG

RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA Nº 58, CENTRO - ARAPORÃ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORAMG.GOV.BR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ/MG.
CONTRATADA: RONI HENRIQUE CAMPANATE
PROCESSO: 124/2022.

Objeto: Contratação de cantores(as), DJ(s), duplas, trios e/ou grupos musicais, para compor a programação artística musical nos diversos eventos realizados ou apoiados pelo Município de Araporã.

N. ITEM	CATEGORIA	CRITÉRIO DISTINTIVO	REMUNERAÇÃO POR EVENTO
03	Público estimado - ENTRE 1500 A 2500 espectadores	B. --BANDA	R\$ 5.200,00

Prazo: A contratação vigorará até o dia 16/06/2023, data de realização do show, tendo por início a data de sua assinatura.

Data da assinatura: 06/06/2023.

Dotação Orçamentária: 02.04.01.13392.0039.20029.3.3.90.36 Ficha: 230

Fundamentação Legal: A celebração deste Termo de Contrato se dá em conformidade com o decorrente da Inexigibilidade por Credenciamento nº 006/2022, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições deste instrumento convocatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG

RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA Nº 58, CENTRO - ARAPORÃ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORAMG.GOV.BR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ/MG.
CONTRATADA: ABADIO ALVES FERREIRA
PROCESSO: 124/2022.

Objeto: Contratação de cantores(as), DJ(s), duplas, trios e/ou grupos musicais, para compor a programação artística musical nos diversos eventos realizados ou apoiados pelo Município de Araporã.

N. ITEM	CATEGORIA	CRITÉRIO DISTINTIVO	REMUNERAÇÃO POR EVENTO
03	Público estimado - ENTRE 1500 A 2500 espectadores	B. --BANDA	R\$ 5.200,00

Prazo: A contratação vigorará até o dia 18/06/2023, data de realização do show, tendo por início a data de sua assinatura.

Data da assinatura: 06/06/2023.

Dotação Orçamentária: 02.04.01.13392.0039.20029.3.3.90.36 Ficha: 230

Fundamentação Legal: A celebração deste Termo de Contrato se dá em conformidade com o decorrente da Inexigibilidade por Credenciamento nº 006/2022, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições deste instrumento convocatório.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA N° 58, CENTRO - ARAPORÃ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORA.MG.GOV.BR

EXTRATO DO CONTRATO N° 068/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ/MG.
CONTRATADA: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA FILHO
PROCESSO: 124/2022.
Objeto: Contratação de cantores(as), DJ(s), duplas, trios e/ou grupos musicais, para compor a programação artística musical nos diversos eventos realizados ou apoiados pelo Município de Araporã.
N.º ITEM CATEGORIA CRITÉRIO DISTINTIVO REMUNERAÇÃO POR EVENTO
03 Público estimado – ENTRE 1500 A B –BANDA R\$ 5.200,00
2500 espectadores

Prazo: A contratação vigorará até o dia 17/06/2023, data de realização do show, tendo por início a data de sua assinatura.
Data do contrato: 13/06/2023.
Datação Orçamentária: 02.04.01.13392.0039.20029.3.3.90.36 Ficha: 230
Fundamentação Legal: A celebração deste Termo de Contrato se dá em conformidade com o decorrente da Inexigibilidade por Credenciamento nº 006/2022, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições deste instrumento convocatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ-MG
RUA JOSÉ INÁCIO FERREIRA N° 58, CENTRO - ARAPORÃ/MG - 38.465-000
TEL.: (34) 3284-9500 - WWW.ARAPORA.MG.GOV.BR

EXTRATO DO CONTRATO N° 069/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ/MG.
CONTRATADA: CLEBER ROGÉRIO RODRIGUES JÚNIOR
PROCESSO: 124/2022.
Objeto: Contratação de cantores(as), DJ(s), duplas, trios e/ou grupos musicais, para compor a programação artística musical nos diversos eventos realizados ou apoiados pelo Município de Araporã.
N.º ITEM CATEGORIA CRITÉRIO DISTINTIVO REMUNERAÇÃO POR EVENTO
01 Público estimado – até 500 A –DJ R\$ 2.100,00
espectadores

Prazo: A contratação vigorará até o dia 18/06/2023, sendo 03 (três) apresentações durante os dias 16/06/2023 a 18/06/2023 data da última apresentação/realização do show, tendo por início a data de sua assinatura.
Data do contrato: 13/06/2023.
Datação Orçamentária: 02.04.01.13392.0039.20029.3.3.90.36 Ficha: 230
Fundamentação Legal: A celebração deste Termo de Contrato se dá em conformidade com o decorrente da Inexigibilidade por Credenciamento nº 006/2022, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições deste instrumento convocatório.



MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 063/2023



As 13:34:22 horas do dia 24 de Maio de 2023 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) CNPJ e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com o objetivo de realizar a sessão de apresentação pública do objeto pregão eletrônico que tem como objeto: Aquisição de Material BOMBA CIRURGICA ELÉTRICA em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, cuja minuta são anexadas ao PREGÃO Nº 0013/2018/EL012 firmado entre o Município de Araporã e a Procuradoria do Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região de Minas Gerais, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo 1 e demais disposições de Edital.

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Complementar nº 123/06, no(a) substatuto na Lei Federal nº 8.986 de 21 de Junho de 1995 e outras disposições legais no âmbito nacional, visando ao procedimento eletrônico de modo presencial.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no Edital, analisando se propostos recebidos, Atendeu em seguida a lista de lances para desqualificação dos licitantes não habilitados aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participaram deste processo os(as) fornecedor(es) abaixo relacionados:

Fornecedor	CNPJ	Emprego
BARFAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02.036.248/0001-12	Ver Lances
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	78.905.303/0001-26	Ver Lances
INTENMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	38.265.740/0001-46	Ver Lances
LONDROSB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EPELI	43.665.379/0001-07	Ver Lances
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.444.108/0001-95	Ver Lances
CASA HOSPITALAR EMPORALTA	15.763.983/0001-56	Ver Lances
EL404 MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EPELI	15.313.419/0001-63	Ver Lances

Propostas

A participação na presente sessão (sessão pública) constitui aceitação por o proponente expressamente indicar os termos desta oferta e suas anexas, incluindo, necessariamente, suas especificações por meio eletrônico, sendo que a sua proposta constitui oferta definitiva e irrevogável. Termo de Referência: "DECLARAR QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Mesa	Modelo	Proposta	RS	Situação	Motivo
54446	BARFAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02036248000112	PROPRIA	PROPRIA	RS	116,000,00	Classificada	-
18589	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	78905303000126	PRÓPRIA	PRÓPRIA	RS	175,000,00	Classificada	-
98903	INTENMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	38265740000146	KSS	WEBE ELETRICA T4 + KIT DOTO	RS	180,000,00	Classificada	-
32426	LONDROSB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EPELI	43665379000107	NOVAMED	MEC 146L	RS	205,000,00	Classificada	-
23123	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34444108000195	NOVAMED	146L	RS	100,000,00	Classificada	-
54114	CASA HOSPITALAR EMPORALTA	15763983000156	KSS	WEBE T	RS	75,000,00	Classificada	-
58834	EL404 MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EPELI	15313419000163	NOVAMED	MEDOS 146L	RS	200,000,00	Classificada	-

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance	RS	Definitiva	Tipo
EL404 MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EPELI	15.313.419/0001-63	200,000,00	RS	24/05/2023 10:22:10	Classificado
LONDROSB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EPELI	43.665.379/0001-07	240,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
INTENMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	38.265.740/0001-46	240,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	78.905.303/0001-26	220,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
BARFAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02.036.248/0001-12	116,000,00	RS	18/05/2023 15:00:29	Classificado
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	78.905.303/0001-26	240,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
INTENMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	38.265.740/0001-46	240,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.444.108/0001-95	100,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
BARFAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02.036.248/0001-12	87,000,00	RS	24/05/2023 13:48:24	Intermediário
BARFAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02.036.248/0001-12	87,000,00	RS	24/05/2023 13:47:10	Intermediário
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	78.905.303/0001-26	88,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
INTENMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA	38.265.740/0001-46	88,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
CASA HOSPITALAR EMPORALTA	15.763.983/0001-56	75,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.444.108/0001-95	75,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
CASA HOSPITALAR EMPORALTA	15.763.983/0001-56	75,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.444.108/0001-95	75,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
LONDROSB IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EPELI	43.665.379/0001-07	75,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
CASA HOSPITALAR EMPORALTA	15.763.983/0001-56	75,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.444.108/0001-95	75,000,00	RS	24/05/2023 08:44:24	Fornecedor Desclassificado



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2023 14:15:10	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, S/SL Fornecedores, Foi aberto prazo de 2 horas para envio da PROPOSTA FINAL melhor classificada até o momento. Foi aberto prazo de 2 horas para envio de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (FOLDERS, CATÁLOGOS, QUE CONTENHAM A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO). Após esse prazo, os documentos encaminhados serão analisados e será verificado se atende o descritivo do edital. OBS.: O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PODERÁ ACARREAR A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. Retornaremos ao final do prazo estipulado para dar continuidade do certame. Peço que fiquem atentos aos Avisos. Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/05/2023 14:20:28	O fornecedor CASA HOSPITALAR IPOROA LTDA acabou de ENVIAR proposta_elettronica_1649448226 no processo final.
Sistema	24/05/2023 14:25:58	O fornecedor CASA HOSPITALAR IPOROA LTDA acabou de ENVIAR documento_documento_1649448226 no habilitar.
Sistema	24/05/2023 15:59:56	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, A sessão ficará SUSPENSA, para análise técnica do Hospital Municipal João Paulo II, por se tratar de um aparelho hospitalar de alta complexidade, por este motivo, retornaremos amanhã (26/05/2023), quinta-feira, às 13:30h, para dar andamento as demais fases pertinentes a este certame. Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/05/2023 16:13:02	O prazo para o fornecedor CASA HOSPITALAR IPOROA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	24/05/2023 16:13:02	O prazo para o fornecedor CASA HOSPITALAR IPOROA LTDA enviar os documentos complementares está encerrado.
Sistema	25/05/2023 16:40:40	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, Boa tarde, após o presente momento a equipe técnica do Hospital não encontrou a resposta em relação a análise da proposta encaminhada sendo assim o horário do sistema será liberado para hoje, 25/05/2023 às 16:00h. Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/05/2023 16:57:56	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, Boa tarde, estamos retornando a sessão. Estarei aguardando 15 minutos para o retorno de todos Elicitados. Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	25/05/2023 16:57:42	Subito que a recusa da proposta encaminhada foi realizada com base na análise técnica do Hospital João Paulo II.
Pregoeiro	25/05/2023 16:58:47	Esta aberto o prazo para negociação, existe margem para negociação, Consegue chegar no valor do primeiro colocado.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	25/05/2023 16:58:16	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL, no rd de menu de Sáb de Depoia, do dia 25/05/2023 16:00:00 até o dia 25/05/2023 18:00:00h para o(s) fornecedor(s). LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI.
Pregoeiro	25/05/2023 16:05:43	O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANT no rd de menu de Sáb de Depoia, do dia 25/05/2023 16:05:00h até o dia 25/05/2023 18:05:00h para o(s) fornecedor(s). LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI.
Sistema	25/05/2023 16:12:57	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, Foi aberto prazo de 2 horas para envio da PROPOSTA FINAL melhor classificada até o momento. Foi aberto prazo de 2 horas para envio de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (FOLDERS, CATÁLOGOS, QUE CONTENHAM A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO). Após esse prazo, os documentos encaminhados serão analisados e será verificado se atende o descritivo do edital. OBS.: O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PODERÁ ACARREAR A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. Retornaremos amanhã (26/05/2023) às 13:30h, momento em que retornaremos para darmos andamento ao certame. Aguardo o retorno de TODOS na data e horário estipulados Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	25/05/2023 18:04:02	O prazo para o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	25/05/2023 18:04:02	O prazo para o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	25/05/2023 18:05:02	O prazo para o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI enviar os documentos complementares está encerrado.
Sistema	26/05/2023 09:01:19	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, Boa dia, em consequência do atraso na análise da proposta na data do dia 25/05/2023 e sessão em vista a sessão negociação realizada em vista de desclassificação de 1ª empresa licitante, visto que a abertura do prazo para envio da PROPOSTA FINAL e DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ocorreu próximo ao término da expediente e a suspensão do certame, possa ter gerado dúvidas e falta de tempo hábil para inserir dos mesmos, Reabrir os prazos mencionados acima até o horário da abertura do certame hoje dia 26/05/2023 às 13:30h. Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	26/05/2023 10:02:06	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL, no rd de menu de Sáb de Depoia, do dia 26/05/2023 10:00:00 até o dia 26/05/2023 12:30:00h para o(s) fornecedor(s). LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI.
Sistema	26/05/2023 11:12:02	O fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI acabou de ENVIAR proposta_documento_documento_1661102226 no processo final.
Sistema	26/05/2023 13:30:01	O prazo para o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI enviar a proposta final está encerrado.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2023 13:37:37	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, Boa tarde, estamos retornando a sessão. Estarei aguardando 15 minutos para o retorno de todos Elicitados. Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	26/05/2023 13:46:20	Subito que a recusa da proposta encaminhada foi realizada com base na análise técnica do Hospital João Paulo II.
Pregoeiro	26/05/2023 13:47:12	Esta aberto o prazo para negociação, existe margem para negociação, Consegue chegar no valor do primeiro colocado.
Pregoeiro	26/05/2023 13:58:19	Boa tarde, preciso em análise de classificação verificamos que o primeiro colocado apresentou equipamento de marca e modelo que já foram objeto de análise e desclassificação, por não atender ao solicitado em Edital. Sendo assim encerramos a negociação para realizar a recusa da proposta de Licidade FUG OBTENEDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Pregoeiro	26/05/2023 14:27:21	Esta aberto o prazo para negociação, existe margem para negociação, Consegue chegar no valor do primeiro colocado.
Pregoeiro	26/05/2023 14:33:33	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL, no rd de menu de Sáb de Depoia, do dia 26/05/2023 14:30:00 até o dia 26/05/2023 16:33:00h para o(s) fornecedor(s). INTENHIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA.
Pregoeiro	26/05/2023 14:34:00	O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANT no rd de menu de Sáb de Depoia, do dia 26/05/2023 14:30:00 até o dia 26/05/2023 16:33:00h para o(s) fornecedor(s). INTENHIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	26/05/2023 14:37:45	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, Foi aberto prazo de 2 horas para envio da PROPOSTA FINAL melhor classificada até o momento. Foi aberto prazo de 2 horas para envio de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (FOLDERS, CATÁLOGOS, QUE CONTENHAM A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO). Após esse prazo, os documentos encaminhados serão analisados e será verificado se atende o descritivo do edital. OBS.: O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PODERÁ ACARREAR A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. Retornaremos na data de hoje, ao final do prazo estipulado, momento em que retornaremos para darmos andamento ao certame. Aguardo o retorno de TODOS na data e horário estipulados Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	26/05/2023 16:01:21	O fornecedor INTENHIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA acabou de ENVIAR proposta_documento_documento_1661102226 no processo final.
Sistema	26/05/2023 16:33:01	O prazo para o fornecedor INTENHIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA enviar os documentos complementares está encerrado.
Sistema	26/05/2023 16:33:01	O prazo para o fornecedor INTENHIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	26/05/2023 16:34:48	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, Boa tarde, estamos retornando a sessão. Estarei aguardando 15 minutos para o retorno de todos Elicitados. Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	26/05/2023 16:37:39	Esta aberto o prazo para negociação, existe margem para negociação, Consegue chegar no valor do primeiro colocado.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	26/05/2023 16:38:31	Boa tarde, preciso em análise de classificação verificamos que o primeiro colocado apresentou equipamento de marca e modelo que já foram objeto de análise e desclassificação, por não atender ao solicitado em Edital. Sendo assim encerramos a negociação para realizar a recusa da proposta de Licidade HSE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA.
Pregoeiro	26/05/2023 17:02:18	Esta aberto o prazo para negociação, existe margem para negociação, Consegue chegar no valor do primeiro colocado.
Pregoeiro	26/05/2023 17:04:31	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL, no rd de menu de Sáb de Depoia, do dia 26/05/2023 17:04:00 até o dia 26/05/2023 19:01:00h para o(s) fornecedor(s). BARRIFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
Pregoeiro	26/05/2023 17:05:06	O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANT no rd de menu de Sáb de Depoia, do dia 26/05/2023 17:04:00 até o dia 26/05/2023 19:01:00h para o(s) fornecedor(s). BARRIFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	26/05/2023 17:08:45	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, Foi aberto prazo para envio da PROPOSTA FINAL melhor classificada até o momento. Foi aberto prazo para envio de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (FOLDERS, CATÁLOGOS, QUE CONTENHAM A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO). Após esse prazo, os documentos encaminhados serão analisados e será verificado se atende o descritivo do edital. OBS.: O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PODERÁ ACARREAR A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. Retornarei segunda-feira (29/05/2023) às 14:00h pra dar continuidade ao certame. Peço que fiquem atentos aos Avisos. Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	26/05/2023 17:45:07	O fornecedor BARRIFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA acabou de ENVIAR proposta_documento_documento_1661102226 no processo final.
Sistema	26/05/2023 17:46:24	O fornecedor BARRIFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA acabou de ENVIAR documento_documento_documento_1661102226 no habilitar.
Sistema	26/05/2023 08:21:32	O fornecedor BARRIFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA acabou de ENVIAR documento_documento_documento_1661102226 no habilitar.
Sistema	26/05/2023 08:21:32	O fornecedor BARRIFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA acabou de ENVIAR documento_documento_documento_1661102226 no habilitar.
Sistema	26/05/2023 09:01:01	O prazo para o fornecedor BARRIFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA enviar a proposta final está encerrado.
Sistema	26/05/2023 09:05:02	O prazo para o fornecedor BARRIFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA enviar os documentos complementares está encerrado.
Sistema	26/05/2023 13:37:17	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 S/SL Fornecedores, Boa tarde, em consequência do atraso na análise técnica do Hospital Municipal João Paulo II, estaremos retornando a sessão amanhã (30/05/2023) às 10:00h, momento em que retornaremos para darmos andamento a esta e demais fases deste certame. Aguardo o retorno de TODOS na data e horário estipulados. Sintamse todos desde já NOTIFICADOS.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAPORÃ

PODER EXECUTIVO

Ano: 07 / Edição:1348

Araporã – MG 19 de Junho de 2023.

Sistema	Data/Faixa	Mensagem
Sistema	3099/2023 10:52:38	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 Srs(s). Fornecedor(es), Bom dia, estamos realizando a sessão. Estamos aguardando 15 minutos para o retorno de todos(as) licitantes. Sintetizamos todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	3099/2023 11:10:50	Srs(s). Fornecedor(es), Bom dia, em razão da realização de reunião de reunião, a sessão ficará suspensa, durante o prazo de envio de recursos, retornarei ao final do referido prazo para o envio de novo andamento do sistema. Sintetizamos todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	1896/2023 14:06:24	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 Srs(s). Fornecedor(es), Informo que retornarei a sessão do Pregão Eletrônico nº 018/2023 HOJE às 16:18h para envio de recursos interpostos pela empresa GSI Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda e Inovarcom Comércio de Instrumentos e Med. Hospitalares Ltda. Sintetizamos todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	1896/2023 16:11:43	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023 Srs(s). Fornecedor(es), Bom tarde! Bom dia! Respeitosamente! Esclareceram agora a resposta ao recurso. Aguardarei 10 minutos para que todos os interessados estejam logados. Sintetizamos todos desde já NOTIFICADOS.

Nota mais recente a destacar: foi encerrada a sessão às 16:28:53 horas do dia 19 de Junho de 2023 (por não ter havido nenhum recurso).

CRESTIANE FAGUNDES GUEDES SOARES

Programadora Oficial

ELIZANDRA BORGES DE LIMA

Esposa de Apoio

Autenticação: 3848F345E9D5A368BDECEEA1F9532CE

Sistema	Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
	R\$ 87.200,00	R\$ 101.344,92	14,1545 %	14.144,92

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 87.200,00	R\$ 101.344,92	14,1545 %	14.144,92

Araporã - Minas Gerais, 19 de Junho de 2023

ELIENE SANTANA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 063/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEM) DO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG convoca aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, realizado a disposição do Edital MESA CIRURGICA ELETRICA em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, cujo recurso foi enviado de acordo com o Edital, a seguinte proposta vencedora: Empresa GSI Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda e Inovarcom Comércio de Instrumentos e Med. Hospitalares Ltda, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo de demais especificações do Edital, que ADJUDICA nos termos do Edital (R\$ 17 do Anexo nº 02/2023), a seguir de forma resumida:

Fornecedor : BARRFAS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 02.836.248/0001-12

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unidade Adjudicada	Total Adjudicado	Unidade Orçada	Total Orçada	Econ. %	Econ. R\$
1	1,00	UN	PROPRIA	PROPRIO	R\$ 87.200,00	R\$ 87.200,00	101,344,92	R\$ 101,344,92	14,1545 %	14,144,92

Descrição: MESA CIRURGICA ELETRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS GERAIS E ORTOPEDICOS, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E BARRIL EM REVESTIMENTO DO POLÍMERO, BASE FABRICADA EM AÇO COM ESPISSURA MÍNIMA CAPAZ DE SUPLICAR OS MANEJOS DOS PROCEDIMENTOS COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, REVESTIDA EM AÇO INOX, BASE MÓVEL COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO CINCO POLICEDAS (QUATRO DE APOIO, DOZADA COM BARRIL DE MOVIMENTAÇÃO, TRACÃO, E FREIO), MOTOPROTEÇÃO ALTERNADA ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO CABO E POR CONTROLE LOCALIZADO NA COLUNA DA MESA CIRURGICA, REVESTIDA EM AÇO INOX DO POLÍMERO, COLUNA DE ELEVAÇÃO FABRICADA EM AÇO COMPOSTA DE DOIS (DOIS) COLUNAS (DUAS COM HASTES DE AÇO E AÇO INOX) NÃO FICADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, REVESTIDA EM AÇO INOX, COM AJUSTE DE ELEVAÇÃO ALTA DA COLUNA (CURSO DE NO MÍNIMO 300 MM DE CURSO, OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA ELÉTRICO, ACIONADO POR CONTROLE REMOTO A CABO E NO PAINEL DE CONTROLE NA PRÓPRIA COLUNA DA MESA, POSSUI SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA QUE ATUO ENTRE METAS, CHAVES DO TAMPO COM ESTRUTURA FABRICADO EM FERRO, DE AÇO INOX (INDEFORMÁVEL), COM SISTEMA RESISTENTE A CORROSÃO QUÍMICA, LÍQUIDA, POSSUÍ COMANDO ENTRE A COLUNA DE ELEVAÇÃO E O CHASSIS DO TAMPO ADEQUADA, PROTEÇÃO SANFONADA ELÁSTICA IMPERMEÁVEL, QUE PROTEGE CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, TAMPO INDEFORMÁVEL EM TODA SUA EXTENSÃO PARA USO DE INSTRUMENTOS DE CIRURGIA E DE MESA EM C, E MESA EM D, TODA SUA EXTENSÃO, COM AUMENTO DO DOCUMENTO LONGITUDINAL QUE PROPORCIONA O USO DE SÁLAO DE PAINEL E TAMPO (CONFORME NAS SEQUENTES SEÇÕES: CARCERINA REMOVÍVEL, DORSO, SEGMENTO COMPLEMENTO DO DORSO SENDO REMOVÍVEL, ASSENTO, RECAL, E PERNAS (BARRILAS) REMOVÍVELS E LIBERÁVEIS COM BARRILAS DE ENGATE HÁBIL PODENDO CHEGAR ONDE NECESSARIE, SEÇÕES, REGULAS LATERAIS COM MEDIDA UNIVERSAL EM AÇO INOX (INDEFORMÁVEL) PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FÁCIL ACOMODAMENTO, TAMPO COM POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DAS CARCERINAS (PERNAS) PERNAS) QUE PERMITE MELHOR VISIBILIDADE NO PROCEDIMENTO DO PACIENTE (CAPACIDADE DE CARGA SEGURA DE NO MÍNIMO 200 KG NA POSIÇÃO ZERO CENTRAL, MOVIMENTOS MOTOPROTEGIDOS, REGULAGEM DA ELEVAÇÃO DA ALTAURA COM O AJUSTE DE ALTURA DE NO CURSO DE 300 MM A 1000 MM, TREMELEMBRADO DE MÍNIMO 18 30º GRAUS, REVERSO DO TREMELEMBRADO DE MÍNIMO 18 30º GRAUS, LATERALIDADE NAS MANOBRAS DE 36 18º GRAUS, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO DE MÍNIMO 100 MM PARA UM LADO E 300 MM PARA OUTRO LADO DO DORSO DO TAMPO, COMANDO DOS MOVIMENTOS ELÉTRICO, REALIZADO ATRAVÉS DE BARRILAS ELÉTRICO DE BARRILAS E BARRILAS DE ENERGIA, BARRILAS DE ÓLEO, MOVIMENTAÇÃO DA MESA CIRURGICA ACIONADOS POR NÍVEL, UM CONTROLE REMOTO A CABO E PARA CASO DE EMERGENCIA PAINEL DE COMANDO EFETUADO NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA MESA, DE QUÊ APRESENTA TELAS PARA OS MOVIMENTOS MOTOPROTEGIDOS (MESA, TELAS DE TRATAMENTO E DESTINADO PARA O BARRILAMENTO INOX (INOX), ASER COMANDO DE BARRIL, SORTEIO DE SOBRECORRENTE E FINAL DE CURSO) TELAS DE FUNÇÕES, ENQUANTO ATUADA ATUANDO AS DIFERENTES FUNÇÕES AS DIFERENTES TELAS, TELAS ZERO (ADEQUADA PARA PROCEDIMENTOS) PARA RECEBER MOVIMENTOS DE BARRILAS (BARRILAS) COM VELOCIDADE CONSTANTE (PARTE) E PARA SUAVES (LIBRE DE RUÍDOS, PERMITE NO MÍNIMO AS SEQUENTES POSIÇÕES: RECAL, 180º (RECAL) DIFERENTES COLAS, FLUXO DE ARDOR, SENDO, SEMI-BARRIL, ELEVAÇÃO, TREMELEMBRADO, LATERAL, LIBERÁVEL, ESCALADA, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL PARA OPERAÇÃO, FREIO, HORIZONTAL, POSIÇÃO ZERO, FLEX, REFLEX, DORSO, PERNAS, CARCERINA, ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO (O ARCO DE INFERIORES) E SUPOSTO DE BARRILAS (BARRILAS) NÃO, COMPLEMENTO MÍNIMO DA TABELA ANTERIOR, FÁCIL TRANSMISSÃO DE (COM POSSÍVEL) BARRILAS, INTERNA SISTEMA DE EMERGENCIA PARA CASO DE FALTA DE ENERGIA (COMERCIALIZÁVEL) COM AJUSTAMENTO DE 01 SEMANA, ESTILOS CARGAS BARRILAS E CONTROLE ELÉTRICO (MONTADO E BARRILADO) BARRILADO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, ALIMENTAÇÃO CIRURGICA DE SER CONECTADA A QUALQUER TOMADA DE REDE FRESCAL DE 150-240V, NAS FREQUÊNCIAS DE 50-60 HZ CAPAZ DE FORNECER 300 VA E DOTADO CONEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO CONFORME NBR 5410 E NBR 13534 POSSUÍ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO NBR EC 69591-1.

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Edição e Publicação:
Secretaria de Governo
Rua José Inácio Ferreira nº 58 Centro
Telefone: (34) 3284-9500
Edição: Suelen Monnis Lima de Freitas
Cópias do Diário Oficial do Município podem ser conseguidas no portal da Prefeitura de Araporã:
www.arapora.mg.gov.br